



Р/р 26004192752 МФО380805 в "Райффайзен банк Аваль" м.Київ  
ЄДРПОУ 30264643 свідоцтво № 100256453, ІПН 302646426103

04071 Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 39/20

поштова адреса: 04073 Україна, Київ, а/я 50

тел./факс: +38 044 501.22.36, 501.22.35, 247.06.82

e-mail: info@doctor-pirogov.com, www.doctor-pirogov.com



**«ПАРАФІН»**  
Засіб для аплікацій  
ТМ «ЛАБОРАТОРІЯ ДОКТОРА ПИРОГОВА»  
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Найменування показника	Норма	Фактичні показники
Зовнішній вид	Тверда непрозора пластина, схожа на віск	Відповідає
Колір	Від білого до світло жовтого	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Температура плавлення, оС, не нижче	52,0	55,5
Масова частка води, %	Відсутній	Відповідає
Масова частка олії, %	0,8	0,8
Вміст водорозчинних кислот та лугів	Відсутній	Відповідає
Вміст механічних домішок	Відсутній	Відповідає


Упаковка: пластиковий контейнер 250 гр.

Дата виготовлення: 20.07.2021

Строк зберігання: 36 місяців з дати виготовлення.

Гігієнічний висновок № 05.03.02-04/44734 від 17.07.2008

Висновок: Якість препарату відповідає вимогам ТУ У 24.5-30264643-007:2007



*М.м. № 2160 від 20.07.2021*



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України  
(шлях установи)  
01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7  
(місцезнаходження)  
253-94-84, 559-29-88



А.М.Пonomаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.04 2008р.

№ 05.03.02-04/444804

Засоби для аплікації торгової марки "Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін  
(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 24.52.19.990

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Бальнеологічні заклади, косметологічні салони, торгівля

(сфера застосування та сфери діяльності об'єкта експертизи)

ТОВ "Т.В.К.Групи", Україна, м. Київ, вул.Мельникова, 83, тел.: 247 06 82, e-mail: tvkgroup@ukrnet.net,  
код ЄДРПОУ: 30264643

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Т.В.К.Групи", Україна, м. Київ, вул.Мельникова, 83, тел.: 247 06 82, e-mail: tvkgroup@ukrnet.net,  
код ЄДРПОУ: 30264643

(назва експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Індекс гостроти токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подрозниуючої дії – 0 балів,  
мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультивно-анаеробних мікроорганізмів  
КУО/г (см3) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см3) –  
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) <  
100.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення

є:  
Засоби для аплікації торгової марки "Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін можуть  
бути використані для застосування згідно призначення та способу, вказаному на етикетках за умови дотримання  
застережливих заходів та консультації відповідних спеціалістів. Реалізація продукції через бальнеологічні  
заклади, косметологічні салони, торгівлю при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для аплікації торгової марки  
"Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін, за наявним заявником зразком відповідає  
вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути  
використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: термін придатності 36 місяців від дати виготовлення

Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: Термін дії ТУ У 24.5-30264643-007:2007 "Засоби для аплікації на основі озокериту  
та парафіну"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи  
даний висновок втрачає силу.

(вказати безпеку, які підлягають контролю на кодоні)

(вказати безпеку, які підлягають контролю при місцевому оформленні)

Поточний державний санітарний контроль здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції  
згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної  
промисловості" за показником шкіро-подрозниуючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

(вказати безпеку, які здійснюються при поточному державному санітарному контролі)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної  
екотолії ім. О.М.Мирзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044)  
559-73-73

(інформування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2686 від 11.07.2008р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Свтушенко О.І.

ДКПШ 24.52.19.990

УКНД 71.100.70



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ТОВ "Т.В.К. Група"

А.Я.Пирогов


2015 р.

**ЗМІНА № 2**

**ТУ У 24.5-30264643-007:2007**

**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ НА ОСНОВІ ОЗОКЕРИТУ  
ТА ПАРАФІНУ**

Дата надання чинності з "\_\_\_" \_\_\_ 2015 р.

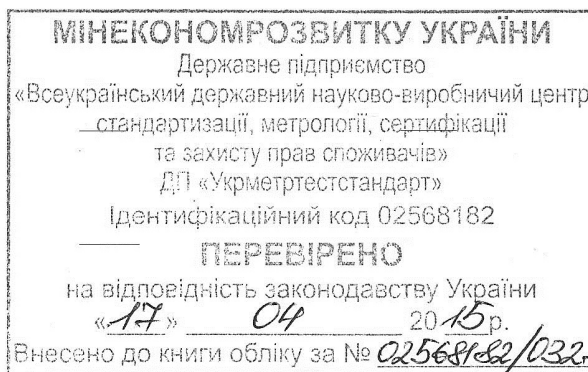

**РОЗРОБЛЕНО**

Заст. директора

ТОВ "Т.В.К. Група"

К.Є. Савіна

"09" 04 2015 г.

**Титульний лист.**

Замінити код «ДКПП 24.52.19.990» на код «ДКПП 20.42.19».

Термін дії ТУ викласти в новій редакції: «до 11.07.2025 р.»

**Розділ 2**, вилучити посилання на такі нормативні документи:

«ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила по охране территорий населенных мест

ДСП 201-97 Державні санітарні правила по охороні атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Доповнити посиланнями на такі нормативні документи:

«ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системы вентиляційні. Загальні вимоги

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затв. наказом МОЗ № 145 від 17.03.2011 р, зареєстровані Мінюстом за № 457/19195 від 05.04.2011 р.


ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування».

**Розділ 4.**

Пункт 4.2, замінити «ГОСТ 12.4.021 і СНиП 2.04.05, водою питною згідно з ГОСТ 2874» на «ДСТУ БА.3.2-12, ДБН В.2.5-67, водою питною згідно з ДСанПіН 2.2.4-171»; «СНиП 2.04.05» на «ДБН В.2.5-67».

Пункт 4.8 вилучити.





Пункт 4.9, замінити «СанПиН 42-128-4690» на «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затв. наказом МОЗ № 145 від 17.03.2011 р.»

### Розділ 6.

Пункт 6.7, замінити «ГОСТ 24104» на «ДСТУ 7270».

Лист 13 викласти в новій редакції:

### «Аркуш затвердження змін

Номер зміни	Номери сторінок				Усього сторінок після внесення змін	Інформація про надходження зміни (номер супровідного листа)	Підпис особи, що внесла зміни	Прізвище цієї особи і дата внесення зміни
	замінених	долучених	вилучених	змінених				

Мінекономрозвитку України  
ДП "Укрметртестстандарт"  
**ПЕРЕВІРЕНО**




Р/р 26004192752 МФО380805 в "Райффайзен банк Аваль" м.Київ  
ЄДРПОУ 30264643 свідоцтво № 100256453, ІПН 302646426103

04071 Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 39/20

поштова адреса: 04073 Україна, Київ, а/я 50

тел./факс: +38 044 501.22.36, 501.22.35, 247.06.82

e-mail: [info@doctor-pirogov.com](mailto:info@doctor-pirogov.com), [www.doctor-pirogov.com](http://www.doctor-pirogov.com)



**«ПАРАФІН»**  
**Засіб для аплікацій**  
**ТМ «ЛАБОРАТОРІЯ ДОКТОРА ПИРОГОВА»**  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ**

Найменування показника	Норма	Фактичні показники
Зовнішній вид	Тверда непрозора пластина, схожа на віск	Відповідає
Колір	Від білого до світло жовтого	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Температура плавлення, оС, не нижче	52,0	55,5
Масова частка води, %	Відсутній	Відповідає
Масова частка олії, %	0,8	0,8
Вміст водорозчинних кислот та лугів	Відсутній	Відповідає
Вміст механічних домішок	Відсутній	Відповідає


**Упаковка: пластиковий контейнер 250 гр.**

**Дата виготовлення: 2019**

**Строк зберігання: 36 місяців з дати виготовлення.**

**Гігієнічний висновок № 05.03.02-04/44734 від 17.07.2008**

**Висновок: Якість препарату відповідає вимогам ТУ У 24.5-30264643-007:2007**





Р/р 26004192752 МФО380805 в "Райффайзен банк Аваль" м.Київ


ЄДРПОУ 30264643 свідоцтво № 100256453, ІПН 302646426103

04071 Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 39/20

поштова адреса: 04073 Україна, Київ, а/я 50

тел./факс: +38 044 501.22.36, 501.22.35, 247.06.82

e-mail: info@doctor-pirogov.com, www.doctor-pirogov.com



**«ПАРАФІН»**  
**Засіб для аплікацій**  
**ТМ «ЛАБОРАТОРІЯ ДОКТОРА ПИРОГОВА»**  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ**

Найменування показника	Норма	Фактичні показники
Зовнішній вид	Тверда непрозора пластина, схожа на віск	Відповідає
Колір	Від білого до світло жовтого	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Температура плавлення, оС, не нижче	52,0	55,5
Масова частка води, %	Відсутній	Відповідає
Масова частка олії, %	0,8	0,8
Вміст водорозчинних кислот та лугів	Відсутній	Відповідає
Вміст механічних домішок	Відсутній	Відповідає


Упаковка: пластиковий контейнер 250 гр.

Дата виготовлення: 03/2021

Строк зберігання: 36 місяців з дати виготовлення.

Гігієнічний висновок № 05.03.02-04/44734 від 17.07.2008

Висновок: Якість препарату відповідає вимогам ТУ У 24.5-30264643-007:2007



Вх. ам № 0189 05 17.03.21



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України  
(шлях установи)  
01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7  
(місцезнаходження)  
253-94-84, 559-29-88



А.М.Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.04 2008р.

№ 05.03.02-04/444804

Засоби для аплікації торгової марки "Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін  
(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 24.52.19.990

(код за ДКПП код за УКТЗЕД артикул)

Бальнеологічні заклади, косметологічні салони, торгівля

(сфера застосування та сфери діяльності об'єкта експертизи)

ТОВ "Т.В.К.Група", Україна, м. Київ, вул.Мельникова, 83, тел.: 247 06 82, e-mail: tvkgroup@ukrnet.net,  
код ЄДРПОУ: 30264643

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Т.В.К.Група", Україна, м. Київ, вул.Мельникова, 83, тел.: 247 06 82, e-mail: tvkgroup@ukrnet.net,  
код ЄДРПОУ: 30264643

(назва експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Індекс гостроти токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подрозниуючої дії – 0 балів,  
мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультивно-анаеробних мікроорганізмів  
КУО/г (см3) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см3) –  
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) <  
100.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення

є:  
Засоби для аплікації торгової марки "Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін можуть  
бути використані для застосування згідно призначення та способу, вказаному на етикетках за умови дотримання  
застережливих заходів та консультації відповідних спеціалістів. Реалізація продукції через бальнеологічні  
заклади, косметологічні салони, торгівлю при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для аплікації торгової марки  
"Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін, за наявним заявником зразком відповідає  
вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути  
використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: термін придатності 36 місяців від дати виготовлення

Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: Термін дії ТУ У 24.5-30264643-007:2007 "Засоби для аплікації на основі озокериту  
та парафіну"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи  
даний висновок втрачає силу.

(вказати безпеку, які підлягають контролю на кодоні)

(вказати безпеку, які підлягають контролю при місцевому оформленні)

Поточний державний санітарний контроль здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції  
згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної  
промисловості" за показником шкіро-подрозниуючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

(вказати безпеку, які здійснюються при поточному державному санітарному контролі)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної  
екотолії ім. О.М.Мирзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044)

559-73-73

(інформування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2686 від 11.07.2008р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Свйшченко О.І.

ДКПШ 24.52.19.990

УКНД 71.100.70



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ТОВ "Т.В.К. Група"

А.Я.Пирогов

2015 р.

**ЗМІНА № 2**

**ТУ У 24.5-30264643-007:2007**

**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ НА ОСНОВІ ОЗОКЕРИТУ  
ТА ПАРАФІНУ**

Дата надання чинності з "\_\_\_" \_\_\_ 2015 р.

<p><b>МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ</b> Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» ДП «Укрметрестандарт» Ідентифікаційний код 02568182</p> <p><b>ПЕРЕВІРЕНО</b> на відповідність законодавству України «17» 04 2015 р. Внесено до книги обліку за № 02568182/032748/02</p>
---

**РОЗРОБЛЕНО**

Заст. директора

ТОВ "Т.В.К. Група"

К.Є. Савіна

"09" 04 2015 г.

**Титульний лист.**

Замінити код «ДКПП 24.52.19.990» на код «ДКПП 20.42.19».

Термін дії ТУ викласти в новій редакції: «до 11.07.2025 р.»

**Розділ 2**, вилучити посилання на такі нормативні документи:

«ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила по охране территорий населенных мест

ДСП 201-97 Державні санітарні правила по охороні атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Доповнити посиланнями на такі нормативні документи:

«ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системы вентиляційні. Загальні вимоги

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затв. наказом МОЗ № 145 від 17.03.2011 р, зареєстровані Мінюстом за № 457/19195 від 05.04.2011 р.

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування».

**Розділ 4.**

Пункт 4.2, замінити «ГОСТ 12.4.021 і СНиП 2.04.05, водою питною згідно з ГОСТ 2874» на «ДСТУ БА.3.2-12, ДБН В.2.5-67, водою питною згідно з ДСанПіН 2.2.4-171»; «СНиП 2.04.05» на «ДБН В.2.5-67».

Пункт 4.8 вилучити.

Мінекономрозвитку України  
ДП "Укрметртестстандарт"  
**ПЕРЕВІРЕНО**

Пункт 4.9, замінити «СанПиН 42-128-4690» на «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затв. наказом МОЗ № 145 від 17.03.2011 р.»

### Розділ 6.

Пункт 6.7, замінити «ГОСТ 24104» на «ДСТУ 7270».

Лист 13 викласти в новій редакції:

### «Аркуш затвердження змін

Номер зміни	Номери сторінок				Усього сторінок після внесення змін	Інформація про надходження зміни (номер супровідного листа)	Підпис особи, що внесла зміни	Прізвище цієї особи і дата внесення зміни
	замінених	долучених	вилучених	змінених				

Мінекономрозвитку України  
ДП «Укрметртестстандарт»  
**ПЕРЕВІРЕНО**



Р/р 26004192752 МФО380805 в "Райффайзен банк Аваль" м.Київ  
ЄДРПОУ 30264643 свідоцтво № 100256453, ІПН 302646426103

04071 Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 39/20

поштова адреса: 04073 Україна, Київ, а/я 50

тел./факс: +38 044 501.22.36, 501.22.35, 247.06.82

e-mail: [info@doctor-pirogov.com](mailto:info@doctor-pirogov.com), [www.doctor-pirogov.com](http://www.doctor-pirogov.com)



**«ПАРАФІН»**  
**Засіб для аплікацій**  
**ТМ «ЛАБОРАТОРІЯ ДОКТОРА ПИРОГОВА»**  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ**

Найменування показника	Норма	Фактичні показники
Зовнішній вид	Тверда непрозора пластина, схожа на віск	Відповідає
Колір	Від білого до світло жовтого	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Температура плавлення, оС, не нижче	52,0	55,5
Масова частка води, %	Відсутній	Відповідає
Масова частка олії, %	0,8	0,8
Вміст водорозчинних кислот та лугів	Відсутній	Відповідає
Вміст механічних домішок	Відсутній	Відповідає


**Упаковка: пластиковий контейнер 250 гр.**

**Дата виготовлення: 2019**

**Строк зберігання: 36 місяців з дати виготовлення.**

**Гігієнічний висновок № 05.03.02-04/44734 від 17.07.2008**

**Висновок: Якість препарату відповідає вимогам ТУ У 24.5-30264643-007:2007**







Р/р 26004192752 МФО380805 в "Райффайзен банк Аваль" м.Київ  
ЄДРПОУ 30264643 свідоцтво № 100256453, ІПН 302646426103

04071 Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 39/20  
поштова адреса: 04073 Україна, Київ, а/я 50  
тел./факс: +38 044 501.22.36, 501.22.35, 247.06.82  
e-mail: info@doctor-pirogov.com, www.doctor-pirogov.com

**«ПАРАФІН»**  
Засіб для аплікацій  
ТМ «ЛАБОРАТОРІЯ ДОКТОРА ПИРОГОВА»  
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Найменування показника	Норма	Фактичні показники
Зовнішній вид	Тверда непрозора пластина, схожа на віск	Відповідає
Колір	Від білого до світло жовтого	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Температура плавлення, оС, не нижче	52,0	55,5
Масова частка води, %	Відсутній	Відповідає
Масова частка олії, %	0,8	0,8
Вміст водорозчинних кислот та лугів	Відсутній	Відповідає
Вміст механічних домішок	Відсутній	Відповідає


Упаковка: пластиковий контейнер 250 гр.

Дата виготовлення: - - КВІ 2021

Строк зберігання: 36 місяців з дати виготовлення.

Гігієнічний висновок № 05.03.02-04/44734 від 17.07.2008

Висновок: Якість препарату відповідає вимогам ТУ У 24.5-30264643-007:2007



Вх.сир № 0186  
140921/2



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України  
(шлях установи)  
01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7  
(місцезнаходження)  
253-94-84, 559-29-88



А.М.Пonomаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.04 2008р.

№ 05.03.02-04/444804

Засоби для аплікації торгової марки "Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін  
(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 24.52.19.990

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Бальнеологічні заклади, косметологічні салони, торгівля

(сфера застосування та сфери діяльності об'єкта експертизи)

ТОВ "Т.В.К.Групи", Україна, м. Київ, вул.Мельникова, 83, тел.: 247 06 82, e-mail: tvkgroup@ukrnet.net,  
код ЄДРПОУ: 30264643

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Т.В.К.Групи", Україна, м. Київ, вул.Мельникова, 83, тел.: 247 06 82, e-mail: tvkgroup@ukrnet.net,  
код ЄДРПОУ: 30264643

(назва експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Індекс гостроти токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подрозниуючої дії – 0 балів,  
мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультивно-анаеробних мікроорганізмів  
КУО/г (см3) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см3) –  
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) <  
100.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення

є:  
Засоби для аплікації торгової марки "Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін можуть  
бути використані для застосування згідно призначення та способу, вказаному на етикетках за умови дотримання  
застережливих заходів та консультації відповідних спеціалістів. Реалізація продукції через бальнеологічні  
заклади, косметологічні салони, торгівлю при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для аплікації торгової марки  
"Лабораторія Доктора Пирогова": парфін, озокерит, озокерафін, за наявним заявником зразком відповідає  
вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути  
використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: термін придатності 36 місяців від дати виготовлення

Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: Термін дії ТУ У 24.5-30264643-007:2007 "Засоби для аплікації на основі озокериту  
та парафіну"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи  
даний висновок втрачає силу.

(вказати безпеку, які підлягають контролю на кодоні)

(вказати безпеку, які підлягають контролю при місцевому оформленні)

Поточний державний санітарний контроль здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції  
згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної  
промисловості" за показником шкіро-подрозниуючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

(вказати безпеку, які здійснюються при поточному державному санітарному контролі)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної  
екотолії ім. О.М.Мирзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044)

559-73-73

(інформування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2686 від 11.07.2008р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Свиатушенко О.І.

ДКПШ 24.52.19.990

УКНД 71.100.70



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ТОВ "Т.В.К. Груп"

А.Я.Пирогов


2015 р.

**ЗМІНА № 2**

**ТУ У 24.5-30264643-007:2007**

**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ НА ОСНОВІ ОЗОКЕРИТУ  
ТА ПАРАФІНУ**

Дата надання чинності з "\_\_\_" \_\_\_ 2015 р.

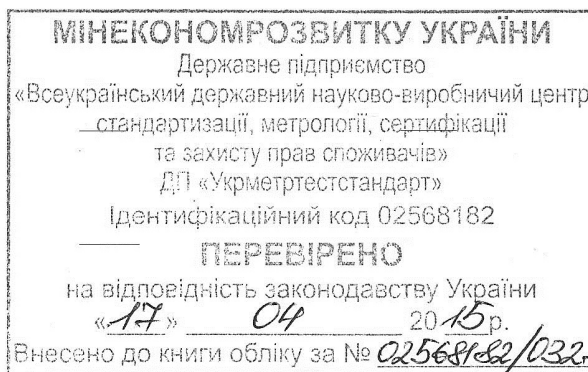

**РОЗРОБЛЕНО**

Заст. директора

ТОВ "Т.В.К. Груп"

К.Є. Савіна

"09" 04 2015 г.

**Титульний лист.**

Замінити код «ДКПП 24.52.19.990» на код «ДКПП 20.42.19».

Термін дії ТУ викласти в новій редакції: «до 11.07.2025 р.»

**Розділ 2**, вилучити посилання на такі нормативні документи:

«ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила по охране территорий населенных мест

ДСП 201-97 Державні санітарні правила по охороні атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Доповнити посиланнями на такі нормативні документи:

«ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затв. наказом МОЗ № 145 від 17.03.2011 р, зареєстровані Мінюстом за № 457/19195 від 05.04.2011 р.


ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування».

**Розділ 4.**

Пункт 4.2, замінити «ГОСТ 12.4.021 і СНиП 2.04.05, водою питною згідно з ГОСТ 2874» на «ДСТУ БА.3.2-12, ДБН В.2.5-67, водою питною згідно з ДСанПіН 2.2.4-171»; «СНиП 2.04.05» на «ДБН В.2.5-67».

Пункт 4.8 вилучити.



Пункт 4.9, замінити «СанПиН 42-128-4690» на «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затв. наказом МОЗ № 145 від 17.03.2011 р.»

### Розділ 6.

Пункт 6.7, замінити «ГОСТ 24104» на «ДСТУ 7270».

Лист 13 викласти в новій редакції:

### «Аркуш затвердження змін»

Номер зміни	Номери сторінок				Усього сторінок після внесення змін	Інформація про надходження зміни (номер супровідного листа)	Підпис особи, що внесла зміни	Прізвище цієї особи і дата внесення зміни
	замінених	долучених	вилучених	змінених				

Мінекономрозвитку України  
ДП «Укрметртестстандарт»  
**ПЕРЕВІРЕНО**



Р/р 26004192752 МФО380805 в "Райффайзен банк Аваль" м.Київ  
ЄДРПОУ 30264643 свідоцтво № 100256453, ІПН 302646426103

04071 Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 39/20

поштова адреса: 04073 Україна, Київ, а/я 50

тел./факс: +38 044 501.22.36, 501.22.35, 247.06.82

e-mail: [info@doctor-pirogov.com](mailto:info@doctor-pirogov.com), [www.doctor-pirogov.com](http://www.doctor-pirogov.com)



**«ПАРАФІН»**  
**Засіб для аплікацій**  
**ТМ «ЛАБОРАТОРІЯ ДОКТОРА ПИРОГОВА»**  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ**

Найменування показника	Норма	Фактичні показники
Зовнішній вид	Тверда непрозора пластина, схожа на віск	Відповідає
Колір	Від білого до світло жовтого	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Температура плавлення, оС, не нижче	52,0	55,5
Масова частка води, %	Відсутній	Відповідає
Масова частка олії, %	0,8	0,8
Вміст водорозчинних кислот та лугів	Відсутній	Відповідає
Вміст механічних домішок	Відсутній	Відповідає

**Упаковка: пластиковий контейнер 250 гр.**

**Дата виготовлення: 2019**

**Строк зберігання: 36 місяців з дати виготовлення.**

**Гігієнічний висновок № 05.03.02-04/44734 від 17.07.2008**

**Висновок: Якість препарату відповідає вимогам ТУ У 24.5-30264643-007:2007**

