

60802

Сертифікат аналізу

Компанія: ПраТ Ілар

№ партії: EC24BV02666-02050

Дата: 04 березня 2024

Дата аналізу: 16 лютого 2024

Кількість: 385 шт.

№ посвідчення: CA-2403-01

Назва виробу: Система моніторингу глюкози крові GlucoDr. авто А AGM-4000; GlucoDr. авто А Глюкометр; GlucoDr. авто А Тест смужки (25 шт.); Ланцетний пристрій; Ланцети (10 шт.); Батарейка (CR2032); Чохол; Інструкція.

Тестові елементи	Характеристика	Тестові процедури	Оцінка
Іше джерело напруги	32-38 мВ	Перевірка допустимого відхилення з використанням пристроїв QC(контроль якості)	пройшов
2ге джерело напруги	307-313 мВ	Перевірка допустимого відхилення з використанням пристроїв QC(контроль якості)	пройшов
Зовнішній вигляд	Збірка, ярлики та зовнішній просвіт	Візуальна експертиза	пройшов
Головний процес (операція)	Потужність, калібрація кнопок, зумер та датчик розпізнання	Перевірка всіх функцій використовуючи пристрої QC (контроль якості)	пройшов
Процес самоконтролю	Тестова смужка	Перевірка з тестовою смужкою	пройшов
Ініціалізація	Ініціалізація пам'яті	Ініціалізація пам'яті зі спеціальною смужкою	пройшов

Увага: перевірити всю продукцію без запісу.

(Logo) Allmedicus


Форма ІО-13 (2003.09.01)

Компанія All Medicus Ltd.

Затверджено
Проранатував дослідник Seo, Dong Woong /підпис/
Уповноважений менеджер Jung, Hye Sook /підпис/

Переклад вірний. Переклад здійснений перекладач ПраТ «ІНДАР» Галінська Є.В. Диплом В20 №237138, виданий Київським національним університетом з лінгвістики та мовознавства

30.06.2020.



for all products
60802

Сертифікат аналізу

Компанія: ПРАТ ІнДАР

№ партії смужок: A24A22271

Дата: 04 березня 2024

Дата аналізу: 30 січня 2024

Умови транспортування: Темп. 24,2°C, вологість: 36,1%

№ посилання : SA-2403-01

Термін придатності: 22 січня 2026

Кількість: 385 коробок

Назва виробу: Система моніторингу глюкози крові GlucoDr. авто А AGM4000; GlucoDr. авто А Глюкометр; GlucoDr. авто А Тест смужки (25 шт.); ланцетний пристрій; ланцети (10 шт.); батарейка (CR2032); вихідні інструкції.


Тестові елементи	Специфікація	Тестові процедури	Оцінка
Інтерфейс та зовнішній вигляд	Одноразова смужка	Аналіз та огляд з використанням лабораторних інструментів	пройшов
Точність	Низький: C/D(SD) менш ніж 4,5 мг/дл Середній: KV(SV) менш ніж 4,5% Високий: KV(SV) менш ніж 4,5%	Використовуючи контрольний розчин глюкози Діапазон концентрації: низький (40 мг/дл $\pm$ 5 мг/дл), середній: (113 мг/дл $\pm$ 5%), високий: (330 мг/дл $\pm$ 5%)	пройшов
Правильність	1. Для концентрації глюкози <100 мг/дл: ≤ 15 мг/дл Для концентрації глюкози ≥ 100 мг/дл: $\leq 15\%$ 2. Зона А і В аналізу Consensus Error Grid (CEG): $\geq 99\%$	Використовують свіжу калібру кров Рекомендований метод: Плазма (YSI інструменти)	пройшов
Безпека	Безпечний	Фізично або хімічно стабільний	пройшов
Стабільність	Середня: відхилення менш ніж 15% Висока: відхилення менш ніж 15%	Використовуючи контрольний розчин глюкози Діапазон концентрації: середній (110-130 мг/дл), високий: (340-370 мг/дл)	пройшов

Застереження: зберігати при температурі (нижче) 2-30°C
(Logo) Allmedicus

Форма 10-13 (2003.09.01)

Компанія All Medicus Ltd.

Переклад вірний. Переклад здійснив перекладач ПРАТ «ІНДАР» Глінівська Є.В. Диплом В20 №237138, виданий Київським національним лінгвістичним університетом 30.06.2020.



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ № 06/05

Виробник: All Medicus Co., Ltd., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, 140 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea/Олл Медікус Ко., Лтд., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, 140 Беолмал-ро, Донган-гу, Анянг-си, Гьонггі-до, 14057, Республіка Корея
(назва та місцезнаходження виробника)

в особі уповноваженого представника виробника в Україні: ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР», вул. Зрошувальна, 5, м. Київ, 02099, Україна, код ЄДРПОУ 21680915, тел/факс: +38(044)566-35-12, e-mail: info@indar.com.ua, що діє за довіреністю виробника All Medicus Co., Ltd./Олл Медікус Ко., Лтд. від 01.02.2022 р.
(назва та місцезнаходження уповноваженого)

в особі: Голови правління Вишневської Любові Вікторівни

підтверджує, що вироби медичні: системи моніторингу рівня глюкози в крові: GlucoDr.auto™ А AGM-4000, GlucoDr.S™ AGM-513S та тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові: GlucoDr.auto™ А AGM-4000, GlucoDr.S™ AGM-513S, перелік В (перелік медичних виробів зазначений у Додатку №1, що є невід'ємною частиною цієї Декларації про відповідність)
(назва продукції)

вироби для самоконтролю, призначені для вимірювання рівня цукру в крові, перелік В згідно Додатку 2 технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro

які виготовляються: All Medicus Co., Ltd., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, 140 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea/Олл Медікус Ко., Лтд., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, 140 Беолмал-ро, Донган-гу, Анянг-си, Гьонггі-до, 14057, Республіка Корея
(назва та місцезнаходження виробника)

відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754, Додатку 4

Технічна документація на медичні вироби розроблена та впроваджена.

Декларацію складено на підставі:

Сертифікату відповідності № UA.TR.098.0086-17 від 05.05.2022 р. дійсний до 04.05.2027 р.

Сертифікат видано: Органом з сертифікації (оцінки відповідності) ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ», вул. Саперно-Слобідська, б. 10, оф. 1, м. Київ, 03028, Україна, атестат про акредитацію в НААУ: №10213, номер призначеного ООВ: UA.TR.098.

Невід'ємною частиною даної Декларації про відповідність є наступний Додаток:
Додаток №1 з переліком медичних виробів:

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника.
Відповідальність за достовірність наданої інформації несе виробник.




(підпис)

06.05.2022 р.
(дата)

Любов Вишневська
(ПІБ)

діє до 04.05.2027 р.
(дата)

Перелік медичних виробів

№	Назва медичного виробу англійською мовою	Назва медичного виробу українською мовою
1	Blood glucose monitoring system GlucoDr. auto™ A AGM-4000 including: carrying case; GlucoDr. auto™ A AGM-4000 Meter; GlucoDr. auto™ A AGM-4000 test strips, 25 pc or 50 pc or 100 pc; battery (CR2032); lancing device; sterile disposable blood lancets, 10 pc.	Система моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr. auto™ A AGM-4000 у складі: переносний футляр; глюкометр GlucoDr. auto™ A AGM-4000; тест-смужки GlucoDr. auto™ A AGM-4000, 25 штук або 50 штук або 100 штук; батарейка (CR2032); скарифікатор; ланцети одноразового використання, стерильні, 10 штук
2	Blood glucose monitoring system GlucoDr.S™ AGM-513S including: carrying case; GlucoDr.S™ AGM-513S Meter; GlucoDr.S™ AGM-513S test strips, 25 pc or 50 pc or 100 pc; battery (CR2032); lancing device; sterile disposable blood lancets, 10 pc.	Система моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr.S™ AGM-513S у складі: переносний футляр; глюкометр GlucoDr.S™ AGM-513S; тест-смужки GlucoDr.S™ AGM-513S, 25 штук або 50 штук або 100 штук; батарейка (CR2032); скарифікатор; ланцети одноразового використання, стерильні, 10 штук
3	Test strips for blood glucose monitoring system GlucoDr. auto™ A AGM-4000, 25 pieces	Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr. auto™ A AGM-4000, 25 штук
4	Test strips for blood glucose monitoring system GlucoDr. auto™ A AGM-4000, 50 pieces	Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr. auto™ A AGM-4000, 50 штук
5	Test strips for blood glucose monitoring system GlucoDr. auto™ A AGM-4000, 100 pieces	Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr. auto™ A AGM-4000, 100 штук
6	Test strips for blood glucose monitoring system GlucoDr.S™ AGM-513S, 25 pieces	Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr.S™ AGM-513S, 25 штук
7	Test strips for blood glucose monitoring system GlucoDr.S™ AGM-513S, 50 pieces	Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr.S™ AGM-513S, 50 штук
8	Test strips for blood glucose monitoring system GlucoDr.S™ AGM-513S, 100 pieces	Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr.S™ AGM-513S, 100 штук

Голова правління
ПрАТ «ІНДАР»





(підпис)

06.05.2022 р.
(дата)

Любов Вишневецька
(ПІБ)

діє до 04.05.2027 р.
(дата)



Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ»
(ТОВ «УЦМСП»)

UA.TR.098

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дійсний до 04.05.2027 р.

Цей сертифікат засвідчує, що продукція:

системи моніторингу рівня глюкози в крові: GlucoDr.auto™ A AGM-4000, GlucoDr.S™ AGM-513S та тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові: GlucoDr.auto™ A AGM-4000, GlucoDr.S™ AGM-513S (згідно Додатку 1)

Перелік В

Відповідає вимогам: Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro» (Додаток 4)

Виробник: Олл Медікус Ко., Лтд., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, 140 Беолмал-ро, Донган-гу, Анянг-си, Гьонггі-до, 14057, Республіка Корея / All Medicus Co., Ltd., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, 140 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea

Місце виробництва: Олл Медікус Ко., Лтд., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, 140 Беолмал-ро, Донган-гу, Анянг-си, Гьонггі-до, 14057, Республіка Корея / All Medicus Co., Ltd., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, 140 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea

Уповноважений представник в Україні: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР», вул. Зрошувальна, 5, м. Київ, 02099, Україна, код за ЄДРПОУ 21680915

Додаткова інформація: контроль відповідності продукції вимогам Додатка 4 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro здійснюється шляхом проведення періодичного наглядання згідно програми

Сертифікат видано: Органом з сертифікації (оцінки відповідності) ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ», вул. Саперно-Слобідська, б. 10, оф. 1, м. Київ, 03028, Україна, атестат про акредитацію в НААУ: №10213, номер призначеного ООВ: UA.TR.098, на підставі рішення щодо результатів сертифікації від 05.05.2022 р. №0086-218:2022

Виробник зобов'язаний інформувати орган з оцінки відповідності про будь-який свій намір істотних змін до затвердженого проекту медичного виробу, які можуть вплинути на відповідність основним вимогам Додатка 1 та Додатка 4 до Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. У випадку порушення умов, за яких було видано сертифікат, орган з оцінки відповідності має право призупинити дію сертифіката або анулювати сертифікат.

Зареєстрований у Реєстрі
ООВ ТОВ «УЦМСП»
05.05.2022 р.* № UA.TR.098.0086-17


Керівник ООВ ТОВ «УЦМСП»




Сергій КУСТОВСЬКИЙ

* Первинна оцінка відповідності – 05.05.2017 р. Перевідається результат оцінки ресертифікації

Чинність сертифіката можна перевірити у Реєстрі ТОВ «УЦМСП», тел.: +38 (044) 593-71-92



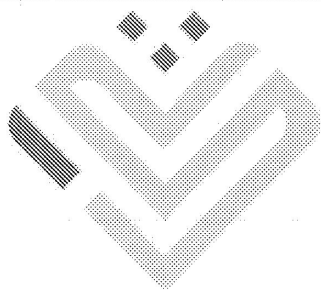

UA.TR.098

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

№ UA.TR.098.0086-17

від 05 травня 2022 р.*

Система моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr.auto™ A AGM-4000

у складі :

- глюкометр GlucoDr.auto™ A AGM-4000;
- тест-смужки GlucoDr.auto™ A AGM-4000, 25 штук або 50 штук або 100 штук;
- батарея (CR2032);
- скарифікатор;
- ланцети одноразового використання, стерильні, 10 штук;
- переносний футляр.

Система моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr.S™ AGM-513S

у складі :

- глюкометр GlucoDr.S™ AGM-513S;
- тест-смужки GlucoDr.S™ AGM-513S, 25 штук, або 50 штук, або 100 штук;
- батарея (CR2032);
- скарифікатор;
- ланцети одноразового використання стерильні, 10 штук;
- переносний футляр.

Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr.auto™ A AGM-4000:

- тест-смужки GlucoDr.auto™ A AGM-4000, 25 штук;
- тест-смужки GlucoDr.auto™ A AGM-4000, 50 штук;
- тест-смужки GlucoDr.auto™ A AGM-4000, 100 штук

Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr.S™ AGM-513S:


- тест-смужки GlucoDr.S™ AGM-513S, 25 штук;
- тест-смужки GlucoDr.S™ AGM-513S, 50 штук;
- тест-смужки GlucoDr.S™ AGM-513S, 100 штук

*На заміну Додатка 1 до сертифіката відповідності від 30.05.2019 р. Перевидано за результатами ресертифікації

Керівник ООВ ТОВ «УЦМСП»




Сергій КУСТОВСЬКИЙ





UA.TR.098

ТОВ „Український центр
медичної сертифікації та прогнозування“



10213
ISO/IEC 17065

80070
ISO/IEC 17021

СЕРТИФІКАТ

ВІДПОВІДНОСТІ

Дійсний до 04 травня 2022 року

Цей сертифікат засвідчує, що продукція (послуга(и)): системи для визначення рівня глюкози в крові: GlucoDr.auto™ AGM 4000, GlucoDr.auto™ A AGM 4000 та тест-смужки: GlucoDr.auto™ AGM 4000, GlucoDr.auto™ A AGM 4000 (згідно Додатку 1)

Перелік В

відповідає вимогам: Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754, додатку 4

Виробник (и): Олл Медікус Ко.,Лтд., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, Беолмал-ро, Донган-гу, Анянг-си, Гьонггі-до, 14057, Республіка Корея (All Medicus Co., Ltd., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea)

Місце (я) виробництва: Олл Медікус Ко.,Лтд., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, Беолмал-ро, Донган-гу, Анянг-си, Гьонггі-до, 14057, Республіка Корея (All Medicus Co., Ltd., #7102~7107, #7402, #7403, #7406, Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea)

Уповноважений представник в Україні: Приватне акціонерне товариство «ІН СУЛІНІВ «ІНДАР», м. Київ, вул. Зрошувальна, 5, код за ЄДРПОУ 21680915

Додаткова інформація контроль відповідності продукції вимогам додатку 4 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro здійснюється шляхом проведення періодичного наглядання згідно програми

Сертифікат видано: Органом з оцінки відповідності ТОВ «Український центр медичної сертифікації та прогнозування» на підставі рішення щодо надання сертифікації від 05.05.2017 № 0086-218:2017 та рішення щодо внесення змін, які стосуються наданої сертифікації від 03.11.2017 р. № 0086-254:2017
ООВ ТОВ «УЦМСП», місцезнаходження ООВ: вул. Саперно-Слобідська, 10, оф.1, м. Київ, 03028, атестати про акредитацію в НААУ: № 10213, 80070, номер призначеного ООВ: UA.TR.098

Виробник зобов'язаний інформувати орган з оцінки відповідності про будь-який свій намір істотних змін до затвердженого проекту медичного виробу, які можуть вплинути на відповідність основним вимогам додатку 1 та додатку 4 до Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. У випадку порушення умов, за яких було видано сертифікат, орган з оцінки відповідності може призупинити дію сертифіката або анулювати сертифікат


Зареєстрований у Ресстрі
ООВ ТОВ «УЦМСП»

03 листопада 2017 року № UA.TR.098.0086-17

Керівник з якості ТОВ «УЦМСП»



Демченко І.Б.



* Перевидано замість сертифіката відповідності від 06.05.2017 р. у зв'язку із внесенням змін

Чинність сертифіката можна перевірити у Ресстрі ТОВ «УЦМСП» тел.: (044) 593-71-92

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ № 8/М

Уповноважений представник виробника в Україні: Приватне акціонерне товариство «ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР»», м. Київ, вул. Зрошувальна, 5, код ЄДРПОУ 21680915, тел./факс: +38(044)566-35-12, e-mail: info@indar.com.ua, за дорученням All Medicus Co., Ltd., #7102-7107, #7402, #7403, #7406, Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea Tel: +82-31-425-8288, Fax: +82-31-422-8589 (Олл Медікус Ко., Лтд., Беолмал-ро, Донган-гу, Анянг-си, Гьонггі-до, 14057, Республіка Корея, тел: +82-31-425-8288, факс+82-31-422-8589) від 13.02.2017 р.

в особі: Голови правління Вишневецької Л.В. підтверджує, що вироби медичні: Системи для визначення рівня глюкози в крові: GlucoDr.auto™ AGM 4000, GlucoDr.auto™ A AGM 4000 та тест-смужки GlucoDr.auto™ AGM 4000, GlucoDr.auto™ A AGM 4000, перелік В (Перелік медичних виробів зазначенні у Додатку № 1, що є невід'ємною частиною цієї Декларації про відповідність)

(назва продукції)

які виготовляються: All Medicus Co., Ltd., #7102-7107, #7402, #7403, #7406, Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea Tel: +82-31-425-8288, Fax: +82-31-422-8589 (Олл Медікус Ко., Лтд., Беолмал-ро, Донган-гу, Анянг-си, Гьонггі-до, 14057, Республіка Корея, тел: +82-31-425-8288, факс+82-31-422-8589)

(назва та місцезнаходження виробника)

відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754, Додатку 4

Технічна документація на медичні вироби розроблена та впроваджена.

Декларацію складено на підставі:

1. Сертифікату відповідності № UA.TR.098.0086-17 від 03.11.2017 р. дійсний до 04.05.2022 р.
2. Сертифікату № UA.Y8.0021-17 на систему управління якістю згідно з вимогами ДСТУ EN ISO 13485:2015 (EN ISO 13485:2012, IDT; ISO 13485:2003, IDT) від 03.11.2017 р. дійсний до 14.05.2020 р.

Сертифікати видано: Органом з сертифікації (оцінки відповідності) ТОВ «Український центр медичної сертифікації та прогнозування», вул. Саперно-Слобідська, б. 10, оф. 1, м. Київ, 03028, атестати про акредитацію в НААУ: № 80070 та № 10213, номер призначеного ООВ: UA.TR.098 на підставі рішення щодо надання сертифікації від 15.08.2017 р. № 0114-218:2017

Декларацію складено під цілковиту відповідальність уповноваженого представника виробника в Україні:

Приватне акціонерне товариство «ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР»», код ЄДРПОУ 21680915

Голова правління
ПРАТ «ПО ВИРОБНИЦТВУ
ІНСУЛІНІВ «ІНДАР»»

М. П.



Вишневецька Л.В.
(ПІБ)

06.11.2017 р.
(дата)

діє до 04.05.2022 р.
(дата)

Перелік медичних виробів

№	Назва медичного виробу англійською мовою	Назва медичного виробу українською мовою
1	Blood Glucose Monitoring System Gluco Dr. auto AGM-4000: Gluco Dr.auto TM Test Meter, GlucoDr. auto TM Test Strip (25T), Lancing Device, Lancets (10EA), Battery (CR2032), Carrying Case	Система для визначення рівня глюкози в крові GlucoDr.auto TM AGM 4000 у складі: глюкометр GlucoDr.auto TM AGM 4000; тест-смужки GlucoDr.auto TM AGM 4000, 25 штук; батарея (CR2032); скарифікатор; ланцети одноразового використання стерильні, 10 штук; переносний футляр
2	Blood Glucose Monitoring System Gluco Dr. auto A AGM-4000: Gluco Dr.auto TM A Test Meter, GlucoDr. auto TM A Test Strip (25T), Lancing Device, Lancets (10EA), Battery (CR2032), Carrying Case	Система для визначення рівня глюкози в крові GlucoDr.auto TM A AGM 4000 у складі : глюкометр GlucoDr.auto TM A AGM 4000; тест-смужки GlucoDr.auto TM A AGM 4000, 25 штук; скарифікатор; ланцети одноразового використання, стерильні, 10 штук; батарея (CR2032); переносний футляр
4	Test strips GlucoDr.auto TM AGM 4000 (25T)	Тест-смужки GlucoDr.auto TM AGM 4000, 25 штук
5	Test strips GlucoDr.auto TM AGM 4000 (50T)	Тест-смужки GlucoDr.auto TM AGM 4000, 50 штук
6	Test strips GlucoDr.auto TM AGM 4000 (100T)	Тест-смужки GlucoDr.auto TM AGM 4000, 100 штук
7	Test strips GlucoDr.auto TM A AGM 4000 (25T)	Тест-смужки GlucoDr.auto TM A AGM 4000, 25 штук
8	Test strips GlucoDr.auto TM A AGM 4000 (50T)	Тест-смужки GlucoDr.auto TM A AGM 4000, 50 штук
9	Test strips GlucoDr.auto TM A AGM 4000 (100T)	Тест-смужки GlucoDr.auto TM A AGM 4000, 100 штук

Голова правління
ПрАТ «ПО ВИРОБНИЦТВО
ІНСУЛІНІВ «ІНДАР»»

М. П.



(підпис)

06.11.2017 р.
(дата)

Вишневська Л.В.
(ПІБ)

до 04.05.2022 р.
(дата)