

<b>CERTIFICATE OF ANALYSIS</b> <i>Certyfikat analizy</i>	<b>No. 571/810/2025/DHR</b> <i>Numer</i>
<b>Product Name/</b> <i>Nazwa Produktu</i>	<b>Droplet, pen needles 31G x 6mm</b>
<b>Catalog Number/</b> <i>Numer Katalogowy</i>	<b>7749</b>
<b>Order Number/</b> <i>Numer Zamowienia</i>	<b>contractNo 07/06/TESTHTL dated 07.06.2011/ZS-1097/2025</b>
<b>Dispatch Number/</b> <i>Numer Listy Wysylkowej</i>	<b>374 / 2025</b>
<b>Label Drawing Revision/</b> <i>Numer Rysunku</i>	<b>810.0200.2.03 R2e</b>
<b>Lot Number/</b> <i>Nr Serii</i>	<b>F46K4</b>
<b>Date Of Production/</b> <i>Data Produkcji</i>	<b>2025-05-05</b>
<b>Lot Quantity/</b> <i>Ilosc</i>	<b>216 boxes</b>
<b>Complete Needle Lot Number/</b> <i>Nr Serii igly kompletnej</i>	<b>N/A</b>
<b>Sterilization Certificate No./ Numer</b> <i>Certyfikat Sterylizacji</i>	<b>296.934</b>
<b>Sterilization Date/</b> <i>Data sterylizacji</i>	<b>2025-05-11</b>
<b>Expiry Date/</b> <i>Data Wzlotosci</i>	<b>2030-05-01</b>
<b>Sterilization Method/</b> <i>Metoda Sterylizacji</i>	<b>Gamma Irradiation Co-60 Min 17,5kGy-Max 38,0kGy</b>

**This document is to confirm that the product was tested for compliance with Product Specification ZN-2014/HTL-810.02 revision 37 by Quality Control and meets the relevant requirements**


*Niniejszy dokument potwierdza, że wyrób został sprawdzony na zgodność z wymaganiami Specyfikacji Produktowej ZN-2014/HTL-810.02 wydanie 37 przez Kontrolę Jakości i spełnia stosowne wymagania tej specyfikacji*

**Date Of Preparing Certificate/ Data Sporządzenia Certyfikatu**  
*Signature/ Podpis*  
*Decision/ Decyzja*

2025-09-11

**ACCEPTED**

SPECJALISTA DS. JAKOSCI  
- HISTORIA WYROBU  
QUALITY SPECIALIST - DHR  
A. KRYSIOL - KASZCZORZAK  
Apteczka Inżynierska - Wodzisław



**Сertificate of analysis №571/810/2025/DHR**

<b>Назва</b>	<b>Голки Дроплет 6мм x 31G, 100 шт</b>
<b>Каталожний номер</b>	<b>7749</b>
<b>Креслення ланцету</b>	<b>810.0200.2.03 R2e</b>
<b>Номер партії</b>	<b>F46K4</b>
<b>Дата виробництва</b>	<b>05.05.2025</b>
<b>Термін придатності</b>	<b>01.05.2030</b>
<b>Метод стерилізації</b>	<b>Гамма радіація Co-60 Min 17,5 kGy – Max 38,0 kGy</b>

Продукція відповідає внутрішньому стандарту ZN-2014/HTL-810.02 rev. 37

Дата 11.09.2025


*Ваша А 1019 619 14.09.25*

**Декларація про відповідність № 1**  
*Declaration of conformity No.: 1*

<b>Назва виробу:</b> <i>Name of medical device:</i>	<b>Haemolance Plus safety lancets, type 420</b> <b>Prolance safety lancets, type 430</b> <b>MediSafe Solo safety lancets, type 520</b> <b>Medlance Plus safety lancets, type 553-556</b> <b>droplet personal lancets, type 560</b> <b>Acti-Lance safety lancets, type 610</b> <b>droplet lancing devices, type 700</b> <b>droplet pen needles, type 810</b> <b>DropSafe safety pen needles, type 820</b>	<b>Haemolance Plus Ланцети безпечні, Тип 420</b> <b>Prolance Ланцети безпечні, Тип 430</b> <b>MediSafe Solo Ланцети безпечні, Тип 520</b> <b>Medlance Plus Ланцети безпечні, Тип 553-556</b> <b>droplet Ланцети персональні, Тип 560</b> <b>Acti-Lance Ланцети безпечні, Тип 610</b> <b>droplet Ланцетний пристрій, Тип 700</b> <b>droplet Голки для шприц-ручок, Тип 810</b> <b>DropSafe Голки безпечні для шприц-ручок, Тип 820</b>
<b>Виробник:</b> <i>Manufacturer:</i>	<b>HTL-Strefa S.A ul. Adamówek 7 95-035 Ozorków, Poland</b> <b>Ейч Ті Ел – СТРЕФА С.А., вул. Адамовек 7, 95-035 Озоркув, Польща</b>	
<b>Виробничі дільниці:</b> <i>Manufacturing sites:</i>	HTL-Strefa S.A ul. Adamówek 7 95-035 Ozorków, Poland Ейч Ті Ел – СТРЕФА С.А., вул. Адамовек 7, 95-035 Озоркув, Польща HTL-Strefa S.A ul. Lotnicza 21h, 99-100 Łęczysa, Poland Ейч Ті Ел – СТРЕФА С.А., вул. Лотніцза 21г, 99-100 Ленчиця, Польща	
<b>Уповноважений представник в Україні:</b> <i>Authorized representative in Ukraine:</i>	<b>ТОВ «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА»,</b> вул. Багговутівська, буд.17-21, м. Київ, 04107, Україна. Тел.: 0 800 21-52-32 Електронна пошта: uarep@cratia.ua, ЄДРПОУ: 38670845  <b>LLC "CRATIA MEDTECKNIKA"</b> 17-21, Baggoutivska Str., Kyiv, 04107, Ukraine. Tel.: 0 800 21-52-32 E-mail: uarep@cratia.ua, USREOU Code: 38670845	
<b>Класифікація:</b> <i>Classification:</i>	<b>Клас ІІа</b> , (згідно Пункту 14 Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 року) <b>Class ІІа (according to Item 14 of Annex 2 of Technical regulation on Medical devices approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013)</b>	
<b>Процедура оцінки відповідності:</b> <i>Conformity Assessment Route:</i>	<b>Додаток 3</b> (за винятком п. 8-11), Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р <b>Annex 3 (excluding p. 8-11), of Technical regulation on Medical devices approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013)</b>	
<b>Номер сертифіката відповідності:</b> <i>Number of Certificate of conformity:</i>	<b>UA.MD.085-17</b>	

Декларація про відповідність № 1 дійсна з <i>Declaration of conformity No.: 1 is valid from</i>	2022-09-01	Редакція: 3 <i>Revision: 3</i>
Декларація про відповідність № 1 дійсна до <i>Declaration of conformity No.: 1 is valid until:</i>	2027-08-31	

<b>Термін дії сертифіката відповідності:</b> <i>Certificate assessment of conformity is valid until:</i>	<p>please provide as per CE validity Cert according to UkrMedCert decision</p>
<b>Призначений орган з оцінки відповідності та його ідентифікаційний код:</b> <i>Conformity assessment body with its identification number:</i>	<p><b>ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»</b>          Адреса місцезнаходження: вул. Драгоманова, будинок 1-А, офіс 2, м. Київ, 02068, Україна          Номер телефону: +38 067 595-02-30          Електронна адреса: <a href="mailto:ukrmedcert@ukrmedcert.org.ua">ukrmedcert@ukrmedcert.org.ua</a>          Веб-сторінка: <a href="https://ukrmedcert.org.ua">https://ukrmedcert.org.ua</a>;</p> <p>Ідентифікаційний код: UA.TR.099</p> <p><b>UKRMEDCERT LTD</b></p> <p><i>Address: 1-A Drahomanova str., office 2, 02068, Kyiv, Ukraine</i>  <i>Telephone: +38 067 595-02-30</i>  <i>E-mail: ukrmedcert@ukrmedcert.org.ua</i>  <i>Website: https://ukrmedcert.org.ua</i></p> <p>Identification code: UA.TR.099</p>
<p><b>HTL-Strefa S.A.</b>, декларує виконання основних вимог щодо медичних виробів, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.  <i>HTL-Strefa S.A. declares the fulfillment of basic requirements for medical devices, according to Annex 1 of Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013.</i></p>	
<p><b>Дана Декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.</b>  <b>This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.</b></p>	

<b>Місце видачі:</b> <i>Place of issue: Ozorków</i>	<b>Дата підпису:</b> <i>Date of signing: 2022-09-01</i>
<b>Підпис уповноваженої особи</b> <i>Signature of Authorized person</i> 	
<b>Назва посади, ПІБ</b> <i>Position, Full Name Regulatory Affairs Manager, Justyna Żemigala</i>	

<b>Декларація про відповідність № 1 дійсна з</b> <i>Declaration of conformity No.: 1 is valid from</i>	<p>2022-09-01</p>	<p>Редакція: 3 Revision: 3</p>
<b>Декларація про відповідність № 1 дійсна до</b> <i>Declaration of conformity No.: 1 is valid until:</i>	<p>2027-08-31</p>	

**Декларація про відповідність № 1**  
*Declaration of conformity No.: 1*
**Історія перегляду / REVISION HISTORY**

№	Вер-сія №	Сторінка	Опис зміни	Внес/ла:	Дата	Дата набрання чинності:
No.	Rev. no.	Page	Change description	Introduced by	Date	Effective date:
1.	1	All	Залучення Декларація про відповідність. --- Declaration of Conformity introduced	Ю. Жемігала J.Żemigala	2017-09-01	2017-09-01
2.	Appendix 2, rev. 2	1	Додано ISO 13485:2016 видалена ДСТУ ISO 13485:2005; EN ISO 13485:2012, EN 980:2008 ДСТУ ISO 14971:2009 замінено на ДСТУ ISO 14971:2015 ДСТУ ISO 15223-1:2015 замінено на ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 ISO 13485:2016 added --- ДСТУ ISO 13485:2005; EN ISO 13485:2012, EN 980:2008 removed ДСТУ ISO 14971:2009 updated to ДСТУ ISO 14971:2015 ДСТУ ISO 15223-1:2015 updated to ДСТУ ISO 15223-1:2018	Ю. Жемігала J.Żemigala	2019-05-17	2019-05-17
	Appendix 1, rev. 2	2, 6	В додатку 1, укладеного англійською мовою: 8948 - Голка 28G виправлено на 18G 7443 - Universal виправлено на Special 8964 - глибина проникнення 1.8 виправлено на 1.6 8965 - глибина проникнення 1.8 виправлено на 1.2 ---- In English part of appendix 1: 8948 - Needle 28G into 18G corrected 7443 - Universal into Special corrected 8964 - penetration depth from 1.8 into 1.6 corrected 8965 - penetration depth from 1.8 into 1.2 corrected			
3.	Declaration Rev. 2	2	Notified Body UKRMEDCERT updated (address, email, website) -- Поновлене повідомлення «УКРМЕДСЕРТ» оновлення (адреса, електронна пошта, веб-сайт)	Ю. Жемігала J.Żemigala	2021-03-22	2021-03-22
	Appendix 2, rev. 3	All	- General revision and update list of standards in compliance with List national standards and the latest versions of international standards used --- - Загальний перегляд та оновлення переліку стандартів відповідно до Переліку національних стандартів та останніх версій використовуваних міжнародних стандартів			

Декларація про відповідність № 1 дійсна з <i>Declaration of conformity No.: 1 is valid from</i>	2022-09-01	Редакція: 3 <i>Revision: 3</i>
Декларація про відповідність № 1 дійсна до <i>Declaration of conformity No.: 1 is valid until:</i>	2027-08-31	

The page (Сторінка) 1 / 1

**HTL-STREFA S.A.**

Adamówek 7, PL-95035 Ozorkow, Poland

T +48 42 270 00 10 • F +48 42 270 00 20 • www.htl-strefa.pl • info@htl-strefa.pl

VAT: PL7321880362 • REGON: 472350579 • District Court for Lodz-Srodmiestcie in Lodz, XX Commercial Department of the National Court Register, KRS: 0000256309, share capital: 2,934,421.10 PLN (paid in full)

4.	Declaration Rev. 3	Page 1	Видалення продуктів: ergoLance Ланцети безпечні, Тип 450 Medlance Ланцети безпечні, Тип 545-549 Наеmofine Голки для шприц-ручок, Тип 810 Removal of products: ergoLance safety lancets, type 450 Medlance safety lancets, type 545-549 Наеmofine pen needles, type 810	А. Куявська-Гайда А. Kujawska-Gajda	2022-08-12	2022-09-01
		Page 2	Новий термін дії сертифіката оцінки відповідності <i>New Validity of Certificate assessment of conformity</i>			
	Appendix 1 Rev. 3	Page 3,4,8,9	Removal of REF: ergoLance 8951, 8952, 8953 Medlance 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 8959 Наеmofine 8978, 8979, 8980, 8981, 8982, 8983, 8984, 8985, 8986. Видалення REF: ergoLance 8951, 8952, 8953 Medlance 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 8959 Наеmofine 8978, 8979, 8980, 8981, 8982, 8983, 8984, 8985, 8986.			

Декларація про відповідність № 1 дійсна з <i>Declaration of conformity No.: 1 is valid from</i>	2022-09-01	Редакція: 3 <i>Revision: 3</i>
Декларація про відповідність № 1 дійсна до <i>Declaration of conformity No.: 1 is valid until:</i>	2027-08-31	

The page (Сторінка) 1 / 1

**Додаток 1 до Декларація про відповідність № 1**  
*Appendix 1 to Declaration of conformity No.: 1*

№	Каталожний номер	Назва медичного виробу українською мовою	Назва медичного виробу англійською мовою
No	Catalogue number	Name of the medical devices in Ukrainian	Name of the medical devices in English
1.	8960	HAEMOLANCE Plus MICRO FLOW Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 28G, Глибина проникнення 1,6 мм, тип 420, 200 шт.	HAEMOLANCE Plus MICRO FLOW Sterile single-use safety lancets, Needle 28G, Penetration depth 1.6 mm, type 420, 200 pcs
2.	8961	HAEMOLANCE Plus LOW FLOW Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 25G, Глибина проникнення 1,4 мм, тип 420, 200 шт.	HAEMOLANCE Plus LOW FLOW Sterile single-use safety lancets, Needle 25G, Penetration depth 1.4 mm, type 420, 200 pcs
3.	8962	HAEMOLANCE Plus NORMAL FLOW Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 21G, Глибина проникнення 1,8 мм, тип 420, 200 шт.	HAEMOLANCE Plus NORMAL FLOW Sterile single-use safety lancets, Needle 21G, Penetration depth 1.8 mm, type 420, 200 pcs
4.	8963	HAEMOLANCE Plus HIGH FLOW Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 18G, Глибина проникнення 1,8 мм, тип 420, 200 шт.	HAEMOLANCE Plus HIGH FLOW Sterile single-use safety lancets, Needle 18G, Penetration depth 1.8 mm, type 420, 200 pcs
5.	8964	HAEMOLANCE Plus MAX FLOW Ланцети безпечні	HAEMOLANCE Plus MAX FLOW Sterile single-use safety lancets,

Додаток 1 до Декларація про відповідність № 1 дійсна з  
*Appendix 1 to Declaration of conformity No.: 1 is valid from*  
 Додаток 1 до Декларація про відповідність № 1 дійсна до  
*Appendix 1 to Declaration of conformity No.: 1 is valid until:*

2022-09-01

2027-08-31

Редакція: 3

*Revision: 3*

The page (Сторінка) 1 / 6

**HTL-STREFA S.A.**

Adamówek 7, PL-95035 Ozorkow, Poland

T +48 42 270 00 10 • F +48 42 270 00 20 • www.htl-strefa.pl • info@htl-strefa.pl

VAT: PL7321880362 • REGON: 472350579 • District Court for Lodz-Srodmiemie in Lodz, XX Commercial Department of the National Court Register, KRS: 0000256309, share capital: 2,934,421.10 PLN (paid in full)

	стерильні одноразового використання, Лезо 1,5 мм, Глибина проникнення 1,6 мм, тип 420, 200 шт.	Blade 1.5 mm, Penetration depth 1.6 mm, type 420, 200 pcs
6.	HAEMOLANCE Plus PAEDIATRIC Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Лезо 1.5 мм, Глибина проникнення 1,2 мм, тип 420, 200 шт.	HAEMOLANCE Plus PAEDIATRIC Sterile single-use safety lancets, Blade 1.5 mm, Penetration depth 1.2 mm, type 420, 200 pcs
7.	PROLANCE Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 28G, Глибина проникнення 1,6 мм, тип 430, 200 шт.	PROLANCE Sterile single-use safety lancets, Needle 28G, Penetration depth 1.6 mm, type 430, 200 pcs
8.	PROLANCE Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 25G, Глибина проникнення 1,4 мм, тип 430, 200 шт.	PROLANCE Sterile single-use safety lancets, Needle 25G, penetration depth 1.4 mm, type 430, 200 pcs
9.	PROLANCE Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 21G, Глибина проникнення 1,8 мм, тип 430, 200 шт.	PROLANCE Sterile single-use safety lancets, Needle 21G, Penetration depth 1.8 mm, type 430, 200 pcs
10.	PROLANCE Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 18G, Глибина проникнення 1,8 мм, тип 430, 200 шт.	PROLANCE Sterile single-use safety lancets, Needle 18G, Penetration depth 1.8 mm, type 430, 200 pcs
11.	PROLANCE Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Лезо 1,5 мм, Глибина проникнення 1,6 мм, тип 430, 200 шт.	PROLANCE Sterile single-use safety lancets, Blade 1.5 mm, Penetration depth 1.6 mm, type 430, 200 pcs
12.	PROLANCE Ланцети безпечні стерильні одноразового	PROLANCE Sterile single-use safety lancets, Blade 1.5 mm,

Додаток 1 до Декларації про відповідність № 1 дійсна з

*Appendix 1 to Declaration of conformity No. 1 is valid from*

Додаток 1 до Декларації про відповідність № 1 дійсна до

*Appendix 1 to Declaration of conformity No. 1 is valid until:*

2022-09-01

2027-08-31

Редакція: 3

Ревізія: 3

The page (Сторінка) 2 / 6

**HTL-STREFA S.A.**

Adamówek 7, PL-95035 Ozorków, Poland

T +48 42 270 00 10 • F +48 42 270 00 20 • www.htl-strefa.pl • info@htl-strefa.pl

VAT: PL7321860362 • REGON: 472350579 • District Court for Łódź-Srodmieście in Łódź, XX Commercial Department of the National Court Register, KRS: 0000256309, share capital: 2,934,421.10 PLN (paid in full)

	використання, Лезо 1.5 мм, Глибина проникнення 1,2 мм, тип 430, 200 шт.	Penetration depth 1.2 mm, type 430, 200 pcs
13.	MediSafe Solo Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Кінчик голки 23G, Глибина проникнення 2,0 мм, тип 520, 200 шт.	MediSafe Solo Sterile single-use safety lancets, needle tip 23G, penetration depth 2.0 mm, type 520, 200 pcs
14.	MediSafe Solo Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Кінчик голки 29G, Глибина проникнення 1,5 мм, тип 520, 200 шт.	MediSafe Solo Sterile single-use safety lancets, needle tip 29G, penetration depth 1.5 mm, type 520, 200 pcs
15.	Medlance Plus SuperLite Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 30G, Глибина проникнення 1,2 мм, тип 553, 200 шт.	Medlance Plus SuperLite Sterile single-use safety lancets, Needle 30G, Penetration depth 1.2 mm, type 553, 200 pcs
16.	Medlance Plus Lite Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 25G, Глибина проникнення 1,5 мм, тип 553, 200 шт.	Medlance Plus Lite Sterile single-use safety lancets, Needle 25G, Penetration depth 1.5 mm, type 553, 200 pcs
17.	Medlance Plus Universal, Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 21G, Глибина проникнення 1,8 мм, тип 554, 200 шт.	Medlance Plus Universal Sterile single-use safety lancets, Needle 21G, Penetration depth 1.8 mm, type 554, 200 pcs
18.	Medlance Plus Extra Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 21G, Глибина проникнення 2,4 мм, тип 555, 200 шт.	Medlance Plus Extra Sterile single-use safety lancets, Needle 21G, Penetration depth 2.4 mm, type 555, 200 pcs
19.	Medlance Plus Special Ланцети безпечні стерильні	Medlance Plus Special Sterile single-use safety lancets, Blade 0.8

Додаток 1 до Декларація про відповідність № 1 дійсна з

*Appendix 1 to Declaration of conformity No.: 1 is valid from*

Додаток 1 до Декларація про відповідність № 1 дійсна до

*Appendix 1 to Declaration of conformity No.: 1 is valid until:*

2022-09-01

2027-08-31

Редакція: 3

*Revision: 3*

The page (Сторінка) 3 / 6

**HTL-STREFA S.A.**

Adamówek 7, PL-95035 Ozorkow, Poland

T +48 42 270 00 10 • F +48 42 270 00 20 • www.htl-strefa.pl • info@htl-strefa.pl

VAT: PL7321880362 • REGON: 472350579 • District Court for Lodz-Srodmiemie in Lodz, XX Commercial Department of the National Court Register, KRS: 0000256309, share capital: 2,934,421.10 PLN (paid in full)

	одноразового використання, Лезо 0,8 мм, Глибина проникнення 2,0 мм, тип 556, 200 шт.	mm, Penetration depth 2.0 mm, type 556, 200 pcs
20.	7745 droplet Ланцети персональні стерильні одноразового використання, 28G (0,36 мм), тип 560, 100 шт.	droplet Sterile single-use personal lancets 28G (0.36 mm), type 560, 100 pcs
21.	7747 droplet Ланцети персональні стерильні одноразового використання, 30G (0,31 мм), тип 560, 100 шт.	droplet Sterile single-use personal lancets 30G (0.31 mm), type 560, 100 pcs
22.	8991 droplet Ланцети персональні стерильні одноразового використання, 33G (0,2 мм), тип 560, 100 шт.	droplet Sterile single-use personal lancets 33G (0.2 mm), type 560, 100 pcs
23.	7746 droplet Ланцети персональні стерильні одноразового використання, 28G (0,36 мм), тип 560, 200 шт.	droplet Sterile single-use personal lancets 28G (0.36 mm), type 560, 200 pcs
24.	7748 droplet Ланцети персональні стерильні одноразового використання, 30G (0,31 мм), тип 560, 200 шт.	droplet Sterile single-use personal lancets 30G (0.31 mm), type 560, 200 pcs
25.	8994 droplet Ланцети персональні стерильні одноразового використання, 33G (0,2 мм), тип 560, 200 шт.	droplet Sterile single-use personal lancets 33G (0.2 mm), type 560, 200 pcs
26.	7441 Acti-Lance Lite Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 28G, Глибина проникнення 1,5 мм, тип 610, 200 шт	Acti-Lance Lite Sterile single-use safety lancets, Needle 28G, Penetration depth 1.5 mm, type 610, 200 pcs
27.	7442 Acti-Lance Universal Ланцети безпечні стерильні одноразового використання, Голка 23G, Глибина проникнення 1,8 мм, тип 610, 200 шт	Acti-Lance Universal Sterile single-use safety lancets, Needle 23G, Penetration depth 1.8 mm, type 610, 200 pcs
28.	7443 Acti-Lance Special Ланцети безпечні стерильні одноразового	Acti-Lance Special Sterile single-use safety lancets, Blade 17G,

Додаток 1 до Декларація про відповідність № 1 дiйсна з

*Appendix 1 to Declaration of conformity No. 1 is valid from*

Додаток 1 до Декларація про відповідність № 1 дiйсна до

*Appendix to Declaration of conformity No. 1 is valid until:*

2022-09-01

Редакція: 3

Ревізія: 3

2027-08-31

The page (Сторінка) 4 / 6

**HTL-STREFA S.A.**

Adamów 7, PL-95035 Ozorków, Poland

T +48 42 270 00 10 • F +48 42 270 00 20 • www.htl-strefa.pl • info@htl-strefa.pl

VAT: PL7321880362 • REGON: 472350579 • District Court for Łódź-Sródmieście in Łódź, XX Commercial Department of the National Court Register, KRS: 0000256309, share capital: 2,934,421.10 PLN (paid in full)

	використання, Лезо 17G Глибина проникнення 2,0 мм, тип 610, 200 шт	Penetration depth 2.0 mm, type 610, 200 pcs
29.	droplet Ланцетний праспрій, тип 700, 1 шт. та додатковий прозорий ковпачок 1 шт.	droplet lancsing device, type 700, 1 pcs i 1 pcs additional clear cap
30.	droplet Голки для шприц-ручок стерильні одноразового використання, 0,33 мм x 10 мм, 29G x 3/8", тип 810, 100 шт.	droplet Sterile, single-use pen needles, 0,33 mm x 10 mm, 29G x 3/8", type 810, 100 pcs
31.	droplet Голки для шприц-ручок стерильні одноразового використання, 0,33 мм x 12 мм, 29G x 1/2", тип 810, 100 шт.	droplet Sterile, single-use pen needles, 0,33 mm x 12 mm, 29G x 1/2", type 810, 100 pcs
32.	droplet Голки для шприц-ручок стерильні одноразового використання, 0,25 мм x 8 мм, 31G x 5/16", тип 810, 100 шт.	droplet Sterile, single-use pen needles, 0,25 mm x 8 mm, 31G x 5/16", type 810, 100 pcs
33.	droplet Голки для шприц-ручок стерильні одноразового використання, 0,25 мм x 5 мм, 31G x 3/16", тип 810, 100 шт.	droplet Sterile, single-use pen needles, 0,25 mm x 5 mm, 31G x 3/16", type 810, 100 pcs
34.	droplet Голки для шприц-ручок стерильні одноразового використання, 0,25 мм x 6 мм, 31G x 1/4", тип 810, 100 шт.	droplet Sterile, single-use pen needles, 0,25 mm x 6 mm, 31G x 1/4", type 810, 100 pcs
35.	droplet Голки для шприц-ручок стерильні одноразового використання, 0,23 мм x 8 мм, 32G x 5/16", тип 810, 100 шт.	droplet Sterile, single-use pen needles, 0,23 mm x 8 mm, 32G x 5/16", type 810, 100 pcs
36.	droplet Голки для шприц-ручок стерильні одноразового використання, 0,23 мм x 6 мм, 32G x 1/4", тип 810, 100 шт.	droplet Sterile, single-use pen needles, 0,23 mm x 6 mm, 32G x 1/4", type 810, 100 pcs
37.	droplet Голки для шприц-ручок стерильні одноразового використання, 0,23 мм x 5 мм, 32G x 3/16", тип 810, 100 шт.	droplet Sterile, single-use pen needles, 0,23 mm x 5 mm, 32G x 3/16", type 810, 100 pcs

Додаток 1 до Декларації про відповідність № 1 дійсна з

*Appendix 1 to Declaration of conformity No.: 1 is valid from*

Додаток 1 до Декларації про відповідність № 1 дійсна до

*Appendix to Declaration of conformity No.: 1 is valid until:*

2022-09-01

2027-08-31

Редакція: 3

*Revision: 3*

The page (Сторінка) 5 / 6

**HTL-STREFA S.A.**

Adamówek 7, PL-95035 Ozorkow, Poland

T +48 42 270 00 10 • F +48 42 270 00 20 • www.htl-strefa.pl • info@htl-strefa.pl

VAT: PL7321880362 • REGON: 472350579 • District Court for Lodz-Srodmiemie in Lodz, XX Commercial Department of the National Court Register, KRS: 0000256309, share capital: 2,934,421.10 PLN (paid in full)

38.	8139	droplet Голки для шприц-ручок стерильні одноразового використання, 0,23 мм x 4 мм, 32G x 5/32", тип 810, 100 шт.	droplet Sterile, single-use pen needles, 0,23 mm x 4 mm, 32G x 5/32", type 810, 100 pcs
39.	8987	DropSafe Голки для шприц-ручок безпечні стерильні одноразового використання, 0,25 мм x 6 мм, 31G x 1/4", тип 820, 100 шт.	DropSafe Sterile, single-use safety pen needles, 0.25 mm x 6 mm, 31G x 1/4", type 820, 100 pcs
40.	8988	DropSafe Голки для шприц-ручок безпечні стерильні одноразового використання, 0,25 мм x 8 мм, 31G x 5/16", тип 820, 100 шт.	DropSafe Sterile, single-use safety pen needles, 0.25 mm x 8 mm, 31G x 5/16", type 820, 100 pcs

Місце видачі:

Place of issue: Ozorków

Дата підпису:

Date of signing: 2022-09-01

Підпис уповноваженої особи

Signature of Authorized person



Назва посади, ПІБ

Position, Full Name Regulatory Affairs Manager, Justyna Żemigala

Додаток 1 до Декларації про відповідність № 1 дійсна з

Appendix 1 to Declaration of conformity No.: 1 is valid from

Додаток 1 до Декларації про відповідність № 1 дійсна до

Appendix to Declaration of conformity No.: 1 is valid until:

2022-09-01

2027-08-31

Редакція: 3

Revision: 3


The page (Сторінка) 6 / 6

**HTL-STREFA S.A.**

Adamówek 7, PL-95035 Ozorków, Poland

T +48 42 270 00 10 • F +48 42 270 00 20 • www.htl-strefa.pl • info@htl-strefa.pl

VAT: PL7321880362 • REGON: 472350579 • District Court for Łódź-Srodmieście in Łódź, XX Commercial Department of the National Court Register, KRS: 0000256309, share capital: 2,934,421.10 PLN (paid in full)

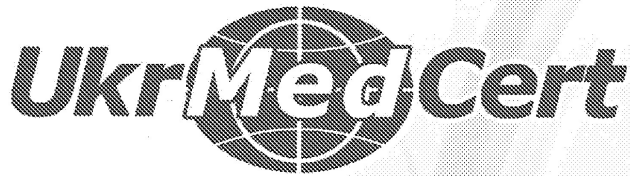

ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

# СЕРТИФІКАТ

про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо  
медичних виробів

Зареєстрований у Реєстрі

«01» вересня 2022 р.

№ UA.MD.085-17

Перше видання «01» вересня 2017 р.

Дійсний до «31» серпня 2027 р.

Цим сертифікатом посвідчується, що застосування комплексної системи управління якістю на етапах проектування, розроблення, виробництва та дистрибуції медичних виробів:

**ланцетів стерильних, одноразового використання; голок для шприц-ручок, стерильних, одноразового використання; безпечних голок для шприц-ручок, стерильних, одноразового використання та ланцетних пристроїв (згідно з додатком)**

*(перелік продукції зазначений на одній сторінці додатку до цього сертифікату)*

клас ІІа

виробника:

**HTL-STREFA S.A.**

за адресою: ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków, Poland;

Виробничі ділянки:

**HTL-STREFA S.A.**

за адресами: ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków, Poland,

ul. Lotnicza 21h, 99-100 Łęczyca, Poland;

уповноважений представник в Україні:

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Кратія Медтехніка»**

за адресою: вул. Багговутівська, будівля 17-21, 6-й поверх, м. Київ, 04107, Україна.

**відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів,**

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753. Процедура оцінки відповідності проведена згідно з додатком 3 «Порядок проведення процедури забезпечення функціонування комплексної системи забезпечення якості» (за виключенням пунктів 8-11 «Перевірка проекту медичного виробу» цього додатка).

Контроль відповідності медичних виробів вимогам зазначеного технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються процедурами органу з оцінки відповідності.

Сертифікат видано Органом з оцінки відповідності ТОВ «УКРМЕДСЕРТ», акредитованим Національним агентством з акредитації України, атестат від 22.03.2021 № 10240, призначеним Мінекономрозвитку України, за ідентифікаційним номером UA.TR.099, адреса: вул. Драгоманова, будинок 1-А, офіс 2, м. Київ, 02059, Україна, тел.: +38-067-595-02-30, <https://ukrmedcert.org.ua> на підставі Рішення ООВ ТОВ «УКРМЕДСЕРТ» від 08.07.2022 № 001/MD-22.04.22/01.

**Керівник ООВ**

  
Ідентифікаційний код 34648777 **Т.П. Сухенко**



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі на сайті <https://ukrmedcert.org.ua>



ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

Додаток до сертифікату про відповідність  
вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів

№ UA.MD.085-17

від 01 вересня 2022 року

№ з/п	Назва медичного виробу англійською мовою	Назва медичного виробу українською мовою
1	Haemolance Plus safety lancets, type 420	Haemolance Plus Ланцети безпечні, Тип 420
2	Prolance safety lancets, type 430	Prolance Ланцети безпечні, Тип 430
3	MediSafe Solo safety lancets, type 520	MediSafe Solo Ланцети безпечні, Тип 520
4	Medlance Plus safety lancets, type 553-556	Medlance Plus Ланцети безпечні, Тип 553-556
5	droplet personal lancets, type 560	droplet Ланцети персональні, Тип 560
6	Acti-Lance safety lancets, type 610	Acti-Lance Ланцети безпечні, Тип 610
7	droplet lancing devices, type 700	droplet Ланцетний пристрій, Тип 700
8	droplet pen needles, type 810	droplet Голки для шприц-ручок, Тип 810
9	DropSafe safety pen needles, type 820	DropSafe Голки безпечні для шприц-ручок, Тип 820

Кінець переліку.

Керівник ООВ



Т.П. Сухенко



ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

# СЕРТИФІКАТ

про відповідність системи управління якістю

Зареєстрований у Реєстрі

«01» вересня 2023 р.

№ UA.SM.054-17

Дійсний до «31» серпня 2026 р.

Перше видання «01» вересня 2017 р.

**ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ,  
ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТОСОВНО**

**проектування, розроблення, виробництва медичних виробів: ланцетів стерильних, одноразового використання; голок для шприц-ручок, стерильних, одноразового використання; безпечних голок для шприц-ручок, стерильних, одноразового використання; ланцетних пристроїв**

впроваджена:

**HTL-STREFA S.A.**

за адресою: **Ozorków 95-035, ul. Adamówek 7, Poland**

з розташуванням виробничих ділянок за адресами:

**ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków, Poland;**


**ul. Lotnicza 21h, 99-100 Łęczycza, Poland**

**відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 13485:2018  
(EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT).**

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються процедурами органу з оцінки відповідності.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ: Органом з оцінки відповідності ТОВ «УКРМЕДСЕРТ», акредитованим Національним агентством з акредитації України, атестації від 15.11.2022 № 80047, адреса: вул. Драгоманова, будинок 1-А, офіс 2, м. Київ, 02059, Україна, тел.: +38-067-595-02-30, <https://ukrmedcert.org.ua>.

Керівник ООВ

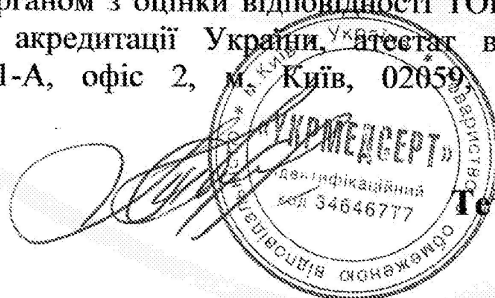

Тетяна СУХЕНКО



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі на сайті <https://ukrmedcert.org.ua>

та за тел. +38-067-595-02-30