

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 007/03-2026 від 10.03.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM032026701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	5630
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-03
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-03
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU Y 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (мм) ± 5%	72 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 25 mm (мм) ± 5%	25 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED" партії AM032026701, дата виготовлення березень 2026 р., відповідає вимогам ТУ Y 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 10.03.2026 р.

Керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 012/01-2026 від 16.01.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202601701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	5670
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-01
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-01
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (мм) ± 5%	72 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 25 mm (мм) ± 5%	25 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED" партії AM202601701, дата виготовлення січень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 16.01.2026 р.

Керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/03-2026 від 04.03.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202603701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	3490
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-03
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-03
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU Y 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (мм) ± 5%	72 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 25 mm (мм) ± 5%	25 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED" партії AM202603701, дата виготовлення березень 2026 р., відповідає вимогам ТУ Y 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 04.03.2026 р.

Керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 009/04-2026 від 03.04.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202604701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	14190
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-04
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-04
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (мм) ± 5%	72 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 25 mm (мм) ± 5%	25 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED" партії AM202604701, дата виготовлення квітень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 03.04.2026 р.

Керівник системи управління якістю



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
 Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
 Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU Y 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ Y 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор

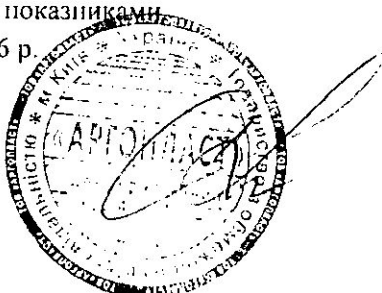

Пугіна С.О.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор

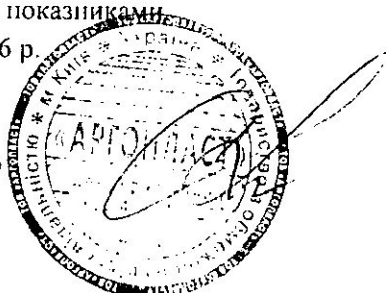

Пугіна С.О. 18.07.2026



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор

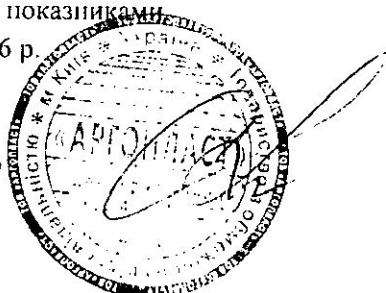

Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»
Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU U 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор

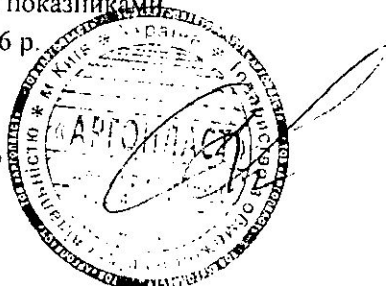

Пугіна С.О.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор

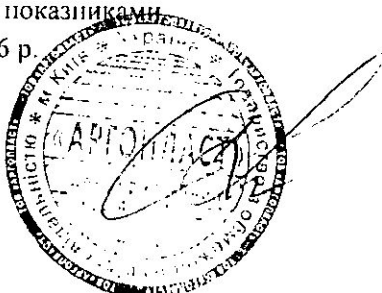

Пугіна С.О.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор

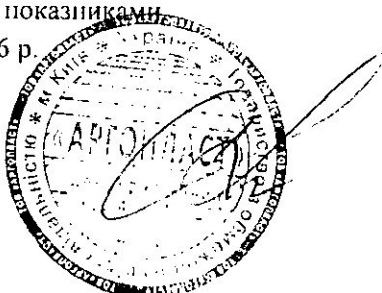

Пугіна С.О.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU U 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор

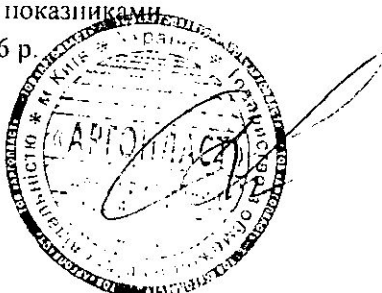

Пугіна С.О.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор

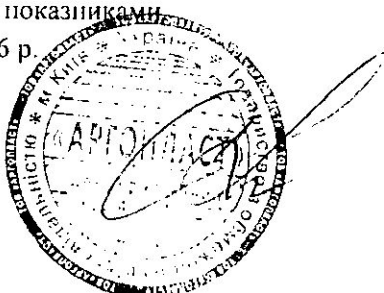

Пугіна С.О.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
 Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
 Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU U 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор

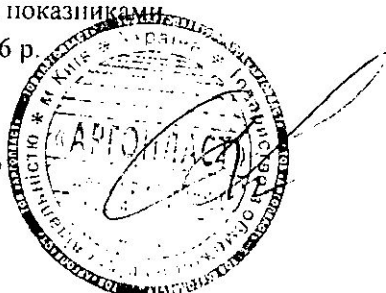

Пугіна С.О.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор

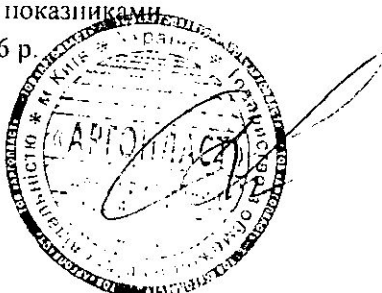

Пугіна С.О.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU U 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор

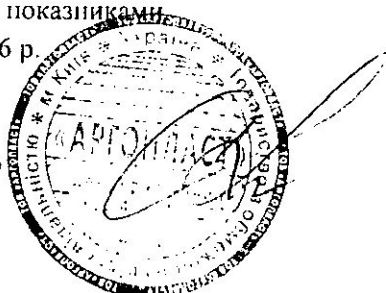

Пугіна С.О.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»
 Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
 Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 036/07-2026 від 31.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	17 840
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (mm) ± 5%	72 mm (mm)	Відповідає
	Ширина 25 mm (mm) ± 5%	25 mm (mm)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 "ANGELMED" партії AM202607701, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 31.07.2026 р.

Директор



ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 028/04-2026 від 22.04.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM300426701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	8540
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-04
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-04
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (мм) ± 5%	72 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 25 mm (мм) ± 5%	25 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED" партії AM300426701, дата виготовлення квітень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 22.04.2026 р.

Керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 028/04-2026 від 22.04.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM300426701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	8540
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-04
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-04
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (мм) ± 5%	72 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 25 mm (мм) ± 5%	25 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED" партії AM300426701, дата виготовлення квітень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 22.04.2026 р.

Керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 028/04-2026 від 22.04.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED"
НОМЕР ПАРТІЇ	AM300426701
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	8540
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-04
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-04
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку еластичної тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса, прикріплений тампон нетканого матеріалу просочений екстрактом алое вера, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	--

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm (мм) ± 5%	72 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 25 mm (мм) ± 5%	25 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній еластичній основі з алое вера 25 mm (мм) × 72 mm (мм) № 10 "ANGELMED" партії AM300426701, дата виготовлення квітень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 22.04.2026 р.

Керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119 м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139

Тел.:+38-067-825-43-51 E-mail: argo_plast@ukr.net

№ 15/12-2025/1

від «15» грудня 2025 р.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГОПЛАСТ»
юридична адреса: вул. Зоологічна, 4-А, оф.139, м. Київ, Україна, 04119
адреси виробництва:

пр-т Леси Курбаса, 2-Б, м. Київ, Україна, 03148,
вул. Київська, буд. 63, с. Святопетрівське, Бучанський р-н, Київська
область, 08141

тел.: +38-067-825-43-51; e-mail: argo_plast@ukr.net

(найменування, місцезнаходження виробника)

підтверджує, що продукція:

**Пластик медичний на тканинній еластичній основі з алоє вера
25 mm (mm) × 72 mm (mm) № 10 «ANGELMED»**

яка випускається згідно з **TU Y 21.2-40101305-001:2016**

клас II а,

(повне найменування медичного виробу, тип, марка, модель,
клас потенційного ризику застосування, код УКТ ЗЕД (для імпортової продукції))

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753
за процедурами, встановленими Додатком 3 (за винятком розділу «Перевірка
проекту медичного виробу») до зазначеного Технічного регламенту.

Застосовні гармонізовані стандарти: ДСТУ EN ISO 13485:2018, ДСТУ ISO
9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ EN ISO 14971:2022, ДСТУ EN ISO
10993-1:2022, ДСТУ EN ISO 10993-5:2015, ДСТУ EN ISO 10993-9:2015, ДСТУ
ISO 10993-10:2004, ДСТУ EN ISO 10993-12:2015, ДСТУ EN ISO 10993-13:2015,
ДСТУ EN ISO 14155:2022, ДСТУ EN ISO 15223-1:2022, ДСТУ EN 1041:2019

Технічна документація на медичні вироби розроблена, впроваджена та
зберігається у виробника

Сертифікат оцінювання відповідності UA.TR.001.0753.14.00540-24
zareestrovanyiy «06» травня 2024 р., дійсний до

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119 м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139

Тел.:+38-067-825-43-51 E-mail: argo_plast@ukr.net

«05» травня 2029 р., виданий органом оцінювання відповідності
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАПДАРТ», вул. Метрологічна,4, м. Київ, Україна,
03143, ідентифікаційний номер UA.TR.001

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника.

Місце складання декларації: пр-т Леся Курбаса, 2-Б, к.27-28,
м. Київ, Україна, 03148

Дата складання декларації: «15» грудня 2025 р.

Термін дії декларації до «05» травня 2029 р.

Директор ТОВ «АРГОПЛАСТ»



С.О. Путіна



10023
Сертифікація
продукції

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0753.14.00540-24
дійсний до 05.05.2029

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

SE "UKRMETRTTESTSTANDARD"

СЕРТИФІКАТ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
(додаток 3 до Технічного регламенту щодо медичних виробів)

Продукція
Product

пластирі медичні гідроколейні,
пластирі медичні з алое вера,
пластирі медичні з іонами срібла
клас ризику ІІа

Торгова марка
Trademark

-

Модель/Тип
Model/Type Ref.

згідно з додатком

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого
постановою КМУ від 02.10.2013 року №753 (для виробів класу ризику ІІа)

Назва та адреса заявника
та/або уповноваженої особи
Name and address of the applicant and/or
authorized representative

ТОВ «АРГОПЛАСТ»,
вул. Зоологічна, 4-А, офіс.139, м. Київ, Україна, 04119

Назва та адреса виробника
Name and address of the manufacturer

ТОВ «АРГОПЛАСТ»,
вул. Зоологічна, 4-А, офіс.139, м. Київ, Україна, 04119

Назва та місцезнаходження
виробництва
Name and location of production

ТОВ «АРГОПЛАСТ»,
проспект Леся Курбаса, 2-Б, м. Київ, Україна, 03148,
вул. Київська, буд. 63, с. Святопетрівське, Бучанський р-н, Київська обл.,
08141

Додаткова інформація
Additional information

Контроль відповідності системи управління якістю вимогам
Технічного регламенту здійснюється шляхом проведення наглядових аудитів
з періодичністю один раз на рік згідно з програмою технічного нагляду.

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

рішення ООВ № 340/403УкрТЕСТ5-24 від 06.05.2024, звіт за результатами
робіт з оцінювання № 340/403УкрТЕСТ5-24 від 03.05.2024, протокол аналізу
технічної документації № 340УкрТЕСТ5-24 від 02.05.2024, протокол аналізу
технічної документації № 403УкрТЕСТ5-24 від 02.05.2024, звіт наглядового
аудиту сертифікованої системи управління якістю №С-765-ПА/2 від 30.04.2024

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of Certification Body

Віктор РИМЕР
Viktor RYMER

Дата
реєстрації: 06.05.2024



Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4-вул. Металургівська, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення звіту сертифіката можливе лише з письмового згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не діє.

This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTTESTSTANDARD" (4, Metalurgivska st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTTESTSTANDARD". The Certificate without signature and stamp is not valid.

Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на веб-сайті: +38 (044) 625-41-32, www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website



10023
Сертифікація
продукції

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0753.14.00540-24
дійсний до 05.05.2029

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток

Addition

до сертифікату оцінювання відповідності
to the conformity assessment certificate

Перелік виробів, на які розповсюджується дія сертифікату:

№ з/п	Найменування виробу	Конструкція	Основа
1	Пластирі медичні гідроколоїдні	стрічка	полімерна
2	Пластирі медичні з алоє вера	стрічка	тканинна, тканинна еластична, шовкова, неткана, неткана еластична, полімерна, полімерна водостійка, полімерна водонепроникна, полімерна еластична
3	Пластирі медичні з іонами срібла	стрічка	тканинна, тканинна еластична, шовкова, неткана, неткана еластична, полімерна, полімерна водостійка, полімерна водонепроникна, полімерна еластична

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of Certification Body

Дата реєстрації: 06.05.2024
Date



Віктор РИМЕР
Victor RYMER