

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Виробник: «Jiangsu Province Jianerkang Medical Dressing Co., LTD», Китай
Zhixi Town, Jintan City, Jiangsu Province, China (Kumay)

Назва продукції: Серветка медична марлева Біола тип 17,
стерильна, 7.5x7.5cm/8шарів, 2шт/пакет

Номер партії: 1355908
Дата виготовлення: 2024.12
Загальна кількість: 20000 пакетів

Нормативні посилання: ДСТУ EN 14079:2009
Термін зберігання: 5 років
Умови зберігання: в сухому місці

Результати випробувань


Назва показника		Норма						Результат
Вимоги згідно з ДСТУ EN 14079:2009								
Ідентифікація волокна		Бавовняне						Бавовняне
Кислотність і лужність		Ні один із розчинів не стає рожевим						6,8 pH
Сторонні волокна		Складаються з бавовняних волокон. Іноді допускається наявність тільки декількох ізольованих сторонніх волокон						Відповідає
Флуоресценція		В УФ світлі при довжині хвилі 365 нм – спостерігається легка коричнево-фіолетова флуоресценція і декілько жовтих частинок. Насиченої синьої флуоресценції не спостерігається (за виключенням показів декількох ізольованих волокон)						Відповідає
Тип марлі		13 легка	17	18	20	22	інший	17
Кількість ниток на 10 см		по основі по утку	70±4 60±4	100±5 70±4	100±5 80±5	120±6 80±5	120±6 100±5	по основі 96 по утку 66
Поверхнева густина, не менше			17,0	23,0	24,0	27,0	30,0	23 г/м²
Розривне навантаження на 50 мм, не менше		по основі по утку	35 20	50 30	50 30	60 35	60 40	по основі 76 Н по утку 46 Н
Час занурення		Не більше 10 с						6 с
Ефірно-розчинні речовини		Не більше 0,50%						0,3 %
Поверхнево-активні речовини		Висота піни над поверхнею рідини після витримки 300 с – не перевищує 2 мм						1,7 мм
Водно-розчинні речовини		Не більше 0,5%						0,3 %
Крохмаль і декстрин		Розчин не повинен проявляти будь-який синій, фіолетовий, червонуватий чи коричнюватий кольори						Відповідає
Екстрагований барвник		Рідина не повинна бути пофарбована більш насичено ніж еталонний розчин						Відповідає
Втрата при сушінні		8,0%						6,5 %
Сульфатна зола		Не більше 0,4% (тип 13 легка – не більше 0,75%)						0,3 %
Білизна		Не менше 80%						81%
Зовнішній вигляд		Дірки, плями, грязь та інші дефекти не допускаються						Відповідає
Розмір		Відхилення не більше 1 см						Відповідає
Кількість в упаковці		2 шт/пакет, 50 пакетів/коробка						Відповідає
ВИСНОВОК: відповідає вимогам ДСТУ EN 14079:2009 і додатковим вимогам								

Уповноважена особа з якості:

Підпис і печатка:

Переклад: Лисенко О.О.

Відомості № 009178 від 21.06.96

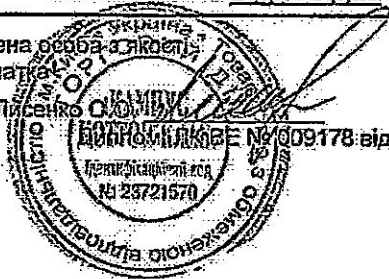

Logomun Jiangsu Province JianErKang Medical Dressing Co., Ltd.
Zhixi Town Jintan City
Jiangsu Province China
Тел.: +86-519-82441138, 82444750
Факс: +86-519-82442535
Ро: 213251
URL: <http://www.chinajek.com>

СВІДОЦТВО ЗІ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЕТИЛЕН ОКСИДОМ

Свідоцтво № M13559

Назва продукту	Партія №	Кількість (пакетів)	К-ть БІ ¹ , що тестувалися	К-ть негативних БІ
Серветка марлева медична	1355906	1500000	1-18	1-18
Серветка марлева медична	1355907	20000	1-18	1-18
Серветка марлева медична	1355908	200000	1-18	1-18
Серветка марлева медична	1355909	10400	1-18	1-18
Серветка марлева медична	1355910	20000	1-18	1-18
Серветка марлева медична	1355911	1020	1-18	1-18

Висновок:

Цим підтверджуємо, що вищенаведена продукція була стерилізована і схвалена відповідно до вимог ISO 11135.

Перевірено (ким)/ Дата:
09 січня 2025р.

Схвалено (ким)/ Дата:
09 січня 2025р.

(Печатка)

Переклад: Лисенко Олександр
Диплом № 009178 від 21.06.96



¹ БІ – біологічний індикатор

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Виробник: «Jiangsu Province Jianerkang Medical Dressing Co., LTD», Китай
Zhixi Town, Jintan City, Jiangsu Province, China (Kumati)

Назва продукції: Серветка медична марлева Віола тип 17,
стерильна, 7.5х7.5см/8шарів, 2шт/пакет

Номер партії: 1370704 Нормативні посилання: ДСТУ EN 14079:2009
Дата виготовлення: 2025-10 Термін зберігання: 5 років
Загальна кількість: 400 000 пакетів Умови зберігання: в сухому місці

Результати випробувань

Назва показника		Норма						Результат
Вимоги згідно з ДСТУ EN 14079:2009								
Ідентифікація волокна		Бавовняне						Бавовняне
Кислотність і лужність		Ні один із розчинів не стає рожевим						6,8 pH
Сторонні волокна		Складаються з бавовняних волокон, іноді допускається наявність тільки декількох ізольованих сторонніх волокон						Відповідає
Флуоресценція		В УФ світлі при довжині хвилі 365 нм – спостерігається легка коричнево-фіолетова флуоресценція і декілько жовтих частинок. Насиченої синьої флуоресценції не спостерігається (за виключенням показів декількох ізольованих волокон)						Відповідає
Тип марлі		13 легка	17	18	20	22	інший	17
Кількість ниток на 10 см		по основі по утку	70±4 60±4	100±5 70±4	100±5 80±5	120±6 80±5	120±6 100±5	по основі 96 по утку 66
Поверхнева густина, не менше		17,0	23,0	24,0	27,0	30,0		23 г/м²
Розривне навантаження на 50 мм, не менше		по основі по утку	35 20	50 30	50 30	60 35	60 40	по основі 76 Н по утку 46 Н
Час занурення		Не більше 10 с						6 с
Ефірно-розчинні речовини		Не більше 0,50%						0,3 %
Поверхнево-активні речовини		Висота піни над поверхнею рідини після витримки 300 с – не перевищує 2 мм						1,7 мм
Водно-розчинні речовини		Не більше 0,5%						0,3 %
Крохмаль і декстрин		Розчин не повинен проявляти будь-який синій, фіолетовий, червонуватий чи коричнюватий кольори						Відповідає
Екстрагований барвник		Рідина не повинна бути пофарбована більш насичено ніж еталонний розчин						Відповідає
Втрата при сушінні		8,0%						6,5 %
Сульфатна зола		Не більше 0,4% (тип 13 легка – не більше 0,75%)						0,3 %
Білизна		Не менше 80%						81%
Зовнішній вигляд		Дірки, плями, грязь та інші дефекти не допускаються						Відповідає
Розмір		Відхилення не більше 1 см						Відповідає
Кількість в упаковці		2 шт/пакет, 50 пакетів/коробка						Відповідає
ВИСНОВОК: <u>відповідає</u> вимогам ДСТУ EN 14079:2009 і додатковим вимогам								

Уповноважена особа: 
Підпис і печатка: 
Переклад: Лисенко О.О. 9178 від 21.06.96



Logomun Jiangsu Province JianErKang Medical Dressing Co., Ltd.
Zhixi Town Jintan City
Jiangsu Province China
Тел.: +86-519-82441138, 82444750
Факс: +86-519-82442535
Ро: 213251
URL: <http://www.chinajek.com>

СВІДОЦТВО ЗІ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЕТИЛЕН ОКСИДОМ

Свідоцтво № M13707

Назва продукту	Партія №	Кількість (пакетів)	К-ть БІ ¹ , що тестувалися	К-ть негативних БІ
Серветка марлева медична	1370703	1 310 000	1-18	1-18
Серветка марлева медична	1370704	400 000	1-18	1-18
Серветка марлева медична	1370705	2040	1-18	1-18

Висновок:

Цим підтверджуємо, що вищенаведена продукція була стерилізована і схвалена відповідно до вимог ISO 11135.

Перевірено (ким)/ Дата:
28 жовтня 2025р.

Схвалено (ким)/ Дата:
28 жовтня 2025р.

(Печатка)

Переклад:  178 від 21.06.96

¹ БІ – біологічний індикатор



ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Виробник: «Jiangsu Province Jianerkang Medical Dressing Co., LTD», Китай
 Zhixi Town, Jintan City, Jiangsu Province, China (Кумаї)
 Назва продукції: Серветка медична марлева Віола тип 17,
 стерильна, 7.5x7.5см/8шарів, 2шт/пакет
 Номер партії: 1377102 Нормативні посилання: ДСТУ EN 14079:2009
 Дата виготовлення: 2025-12 Термін зберігання: 5 років
 Загальна кількість: 500 000 пакетів Умови зберігання: в сухому місці

Результати випробувань

Назва показника		Норма						Результат
Вимоги згідно з ДСТУ EN 14079:2009								
Ідентифікація волокна		Бавовняне						Бавовняне
Кислотність і лужність		Ні один із розчинів не стає рожевим						6,8 pH
Сторонні волокна		Складаються з бавовняних волокон. Іноді допускається наявність тільки декількох ізольованих сторонніх волокон						Відповідає
Флуоресценція		В УФ світлі при довжині хвилі 365 нм – спостерігається легка коричнево-фіолетова флуоресценція і декілько жовтих частинок. Насиченої синьої флуоресценції не спостерігається (за виключенням показів декількох ізольованих волокон)						Відповідає
Тип марлі		13 оакка	17	18	20	22	інший	17
Кількість ниток на 10 см		по основі по утку	70+4 60+4	100+5 70+4	100+5 80+5	120+6 80+5	120+6 100+5	по основі 96 по утку 66
Поверхнева густина, не менше		17,0	23,0	24,0	27,0	30,0		23 г/м²
Розривне навантаження на 50 мм, не менше		по основі по утку	35 20	50 30	50 30	60 35	60 40	по основі 76 Н по утку 46 Н
Час занурення		Не більше 10 с						6 с
Ефірно-розчинні речовини		Не більше 0,50%						0,3 %
Поверхнево-активні речовини		Висота піни над поверхнею рідини після витримки 300 с – не перевищує 2 мм						1,7 мм
Водно-розчинні речовини		Не більше 0,5%						0,3 %
Крохмаль і декстрин		Розчин не повинен проявляти будь-який синій, фіолетовий, червонуватий чи коричнюватий кольори						Відповідає
Екстрагований барвник		Рідина не повинна бути пофарбована більш насичено ніж еталонний розчин						Відповідає
Втрата при сушінні		8,0%						6,5 %
Сульфатна зола		Не більше 0,4% (тип 13 легка – не більше 0,75%)						0,3 %
Білизна		Не менше 80%						81%
Зовнішній вигляд		Дірки, плями, грязь та інші дефекти не допускаються						Відповідає
Розмір		Відхилення не більше 1 см						Відповідає
Кількість в упакованні		2 шт/пакет, 50 пакетів/коробка						Відповідає
ВИСНОВОК: <u>відповідає</u> вимогам ДСТУ EN 14079:2009 і додатковим вимогам								

Уповноважена особа за якістю
 Підпис і печатка

Переклад: Дисейкірію.



Л/Б № 009178 від 21.06.96

